

MEDVIE

Date du test: 11/03/2025 12:01:15

Durée: 4mn 50s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CAMARA LANCINE

Date de naissance 07/06/1985

Age 39

Société CR18


ID 25031111562310615

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

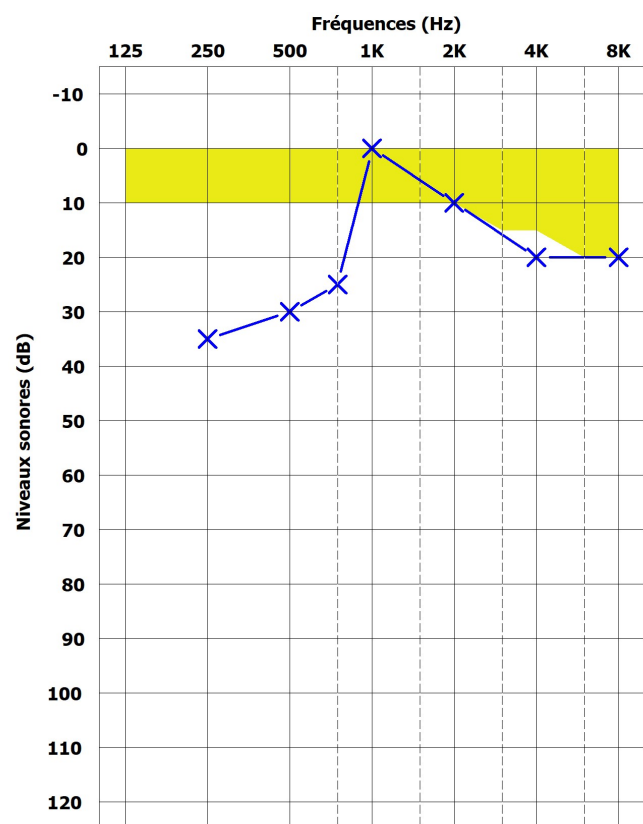

Oreille Gauche

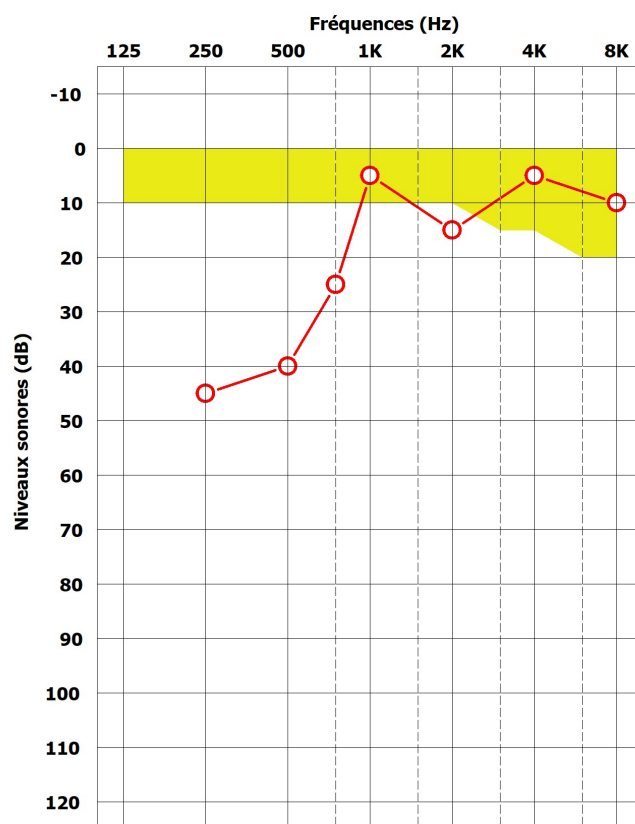

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	30	25	0		10		20		20
CA Droit		45	40	25	5		15		5		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes