


MEDVIE


Date du test: 15/04/2024 18:09:53

Durée: 11mn 45s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

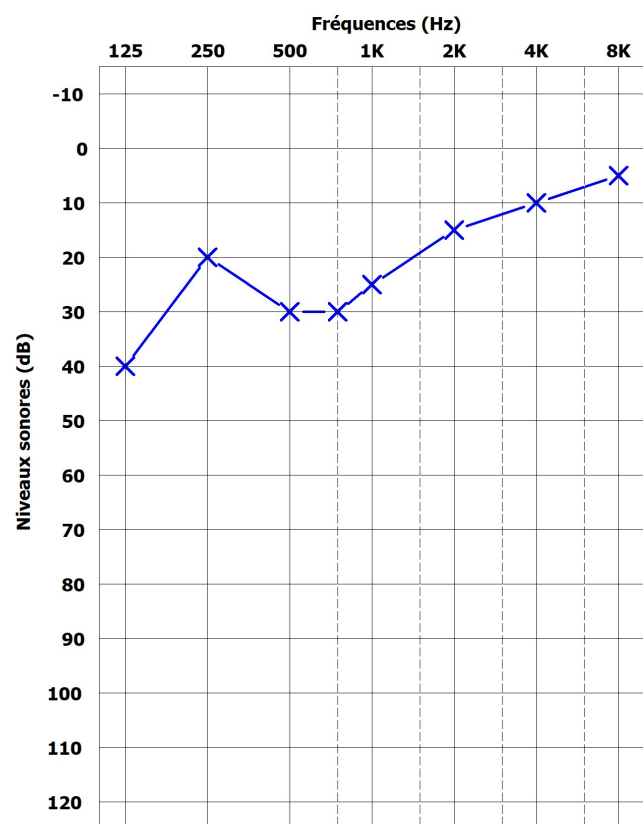

Oreille Gauche

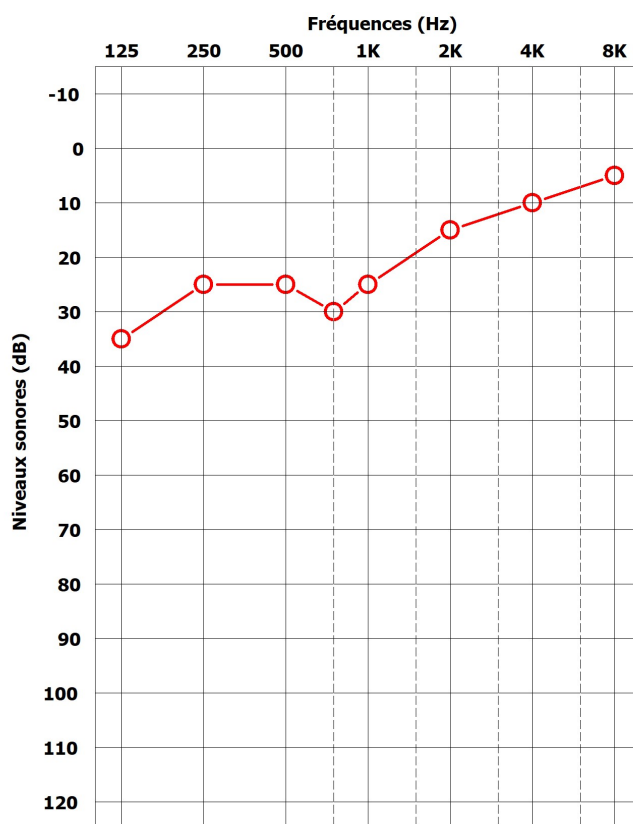

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	20	30	30	25		15		10		5
CA Droit	35	25	25	30	25		15		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA SALIOU
Date de naissance	01/01/1993
Age	31
Société	CR18
ID	24041518070591611

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021