

MEDVIE


Date du test: 29/03/2024 18:55:32

Durée: 12mn 13s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   | CAMARA SIDIKI |
|-------------------|-------------------|---------------|
| Date de naissance | 01/01/1987        |               |
| Age               | 37                |               |
| Société           | CR18              |               |
| ID                | 24032918530193568 |               |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

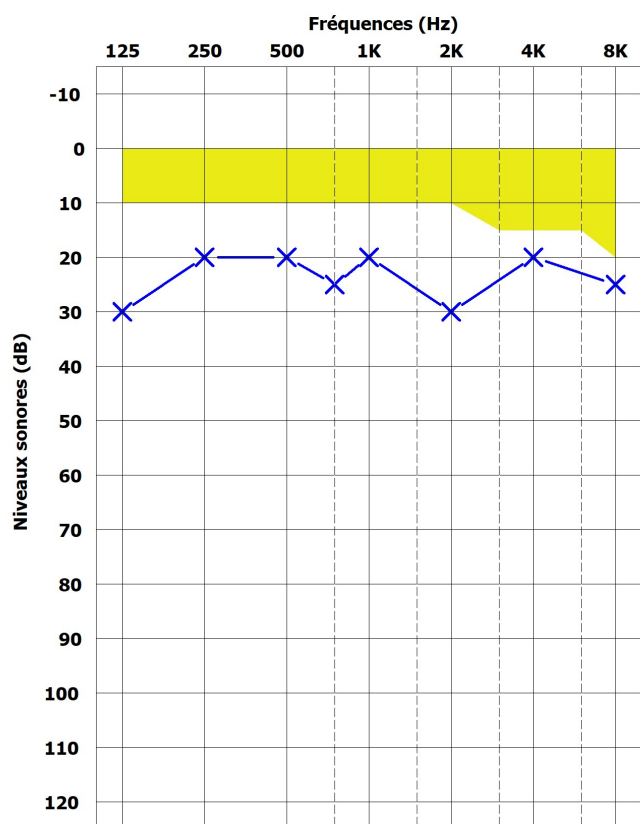

Oreille Gauche

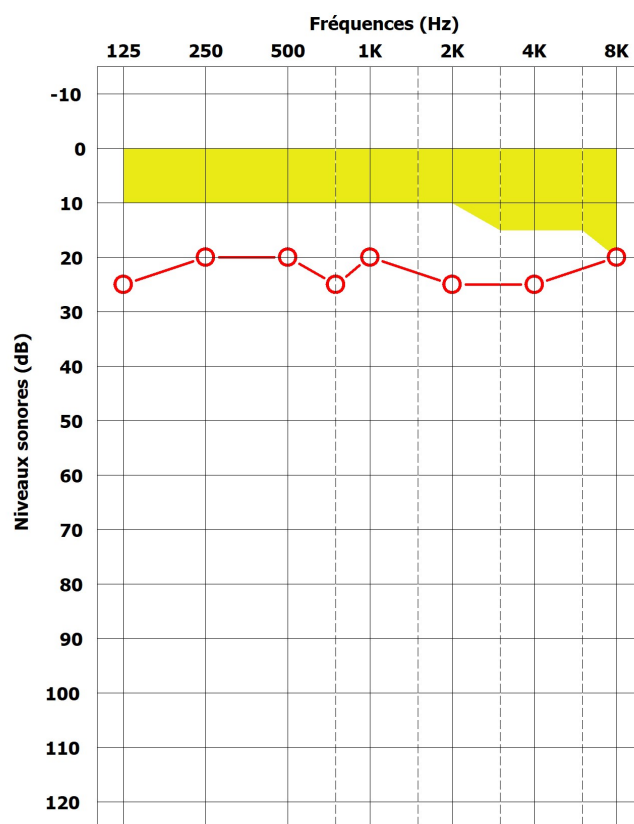

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 30  | 20  | 20  | 25  | 20 |     | 30 |    | 20 |    | 25 |
| CA Droit  | 25  | 20  | 20  | 25  | 20 |     | 25 |    | 25 |    | 20 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 22,5 dB | --- |
| CA Droit        | 22,5 dB | --- |

Notes