


Données Patient	CISSE N'FALY
Date de naissance	01/01/1979
Age	45
Société	CR18
ID	24060116551444241


MEDVIE

Date du test: 01/06/2024 16:56:11
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

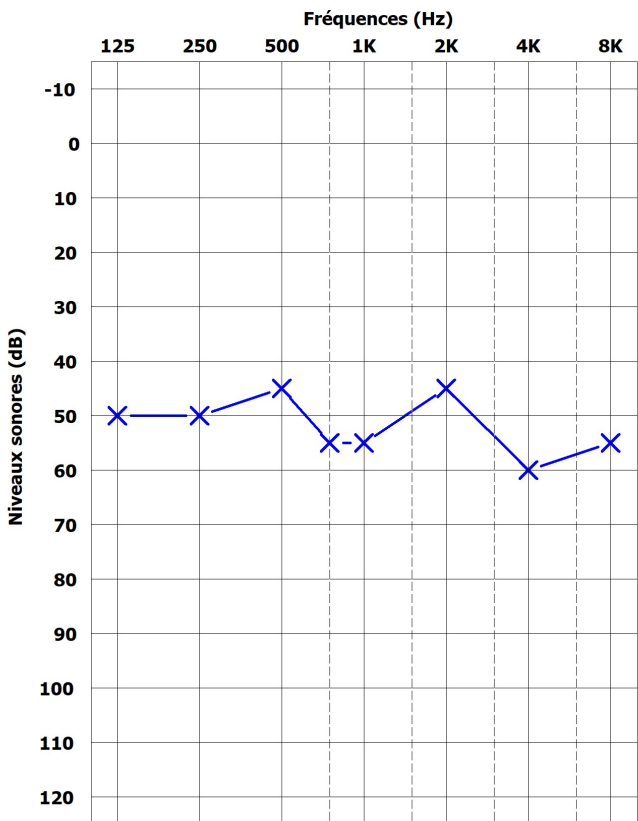

Oreille Gauche

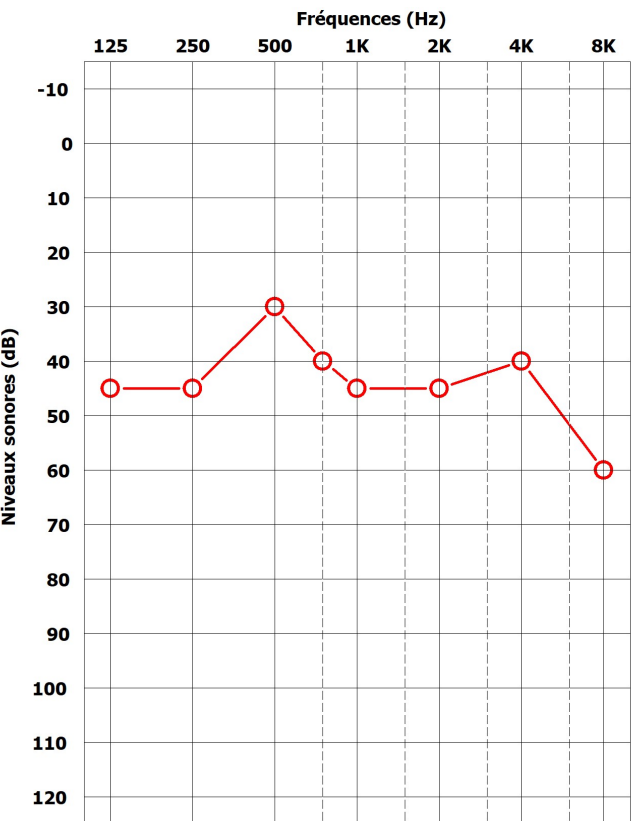

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	50	50	45	55	55		45		60		55
CA Droit	45	45	30	40	45		45		40		60

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	51,3 dB	---
CA Droit	40,0 dB	---

Notes