

MEDVIE


Date du test: 12/03/2025 12:35:56

Durée: 5mn 20s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE MORY
Date de naissance	09/04/1994	
Age	30	
Société	CR18	
ID	25031212334112139	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

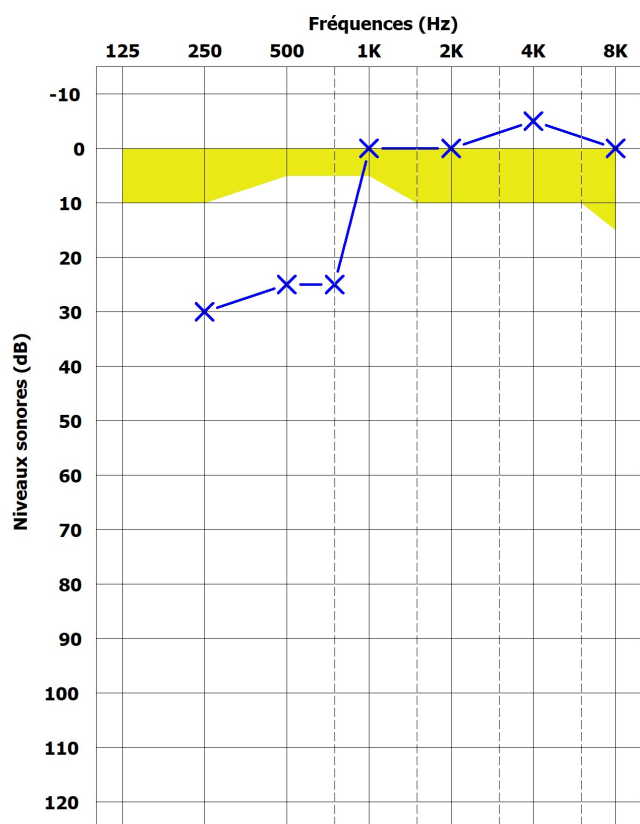

Oreille Gauche

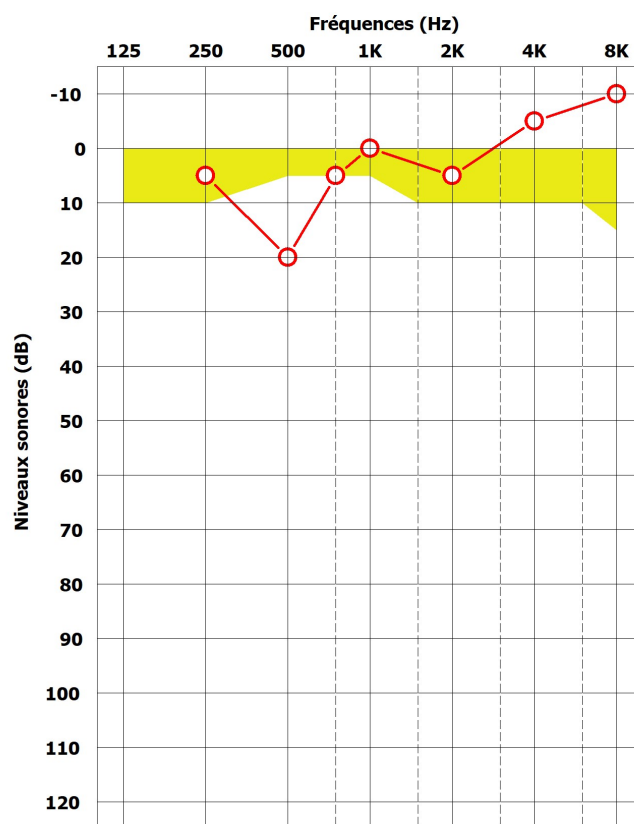

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	0		0		-5		0
CA Droit		5	20	5	0		5		-5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes