


MEDVIE


Date du test: 20/05/2024 15:33:25
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient	
CAMARA FALAYE	
Date de naissance	01/01/2003
Age	21
Société	CR18
ID	24052015290804683

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

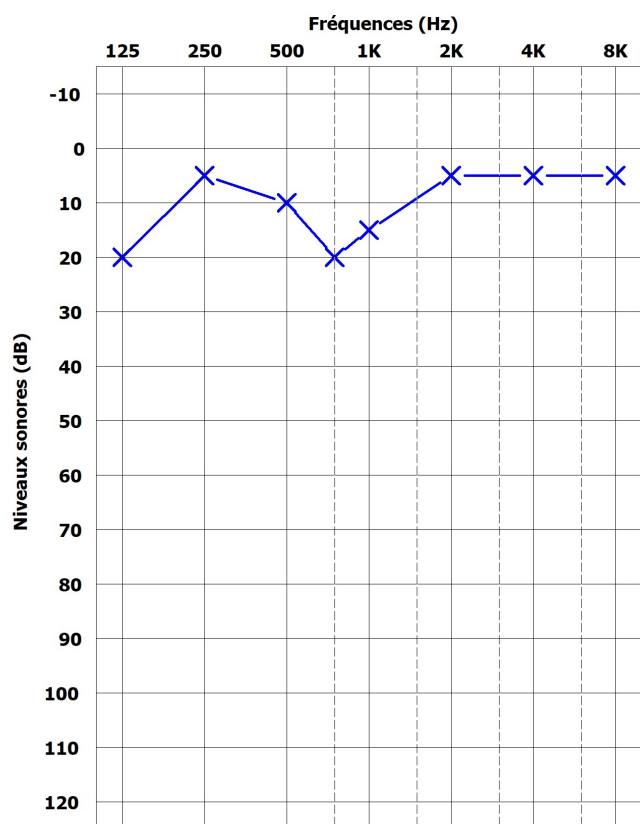

Oreille Gauche

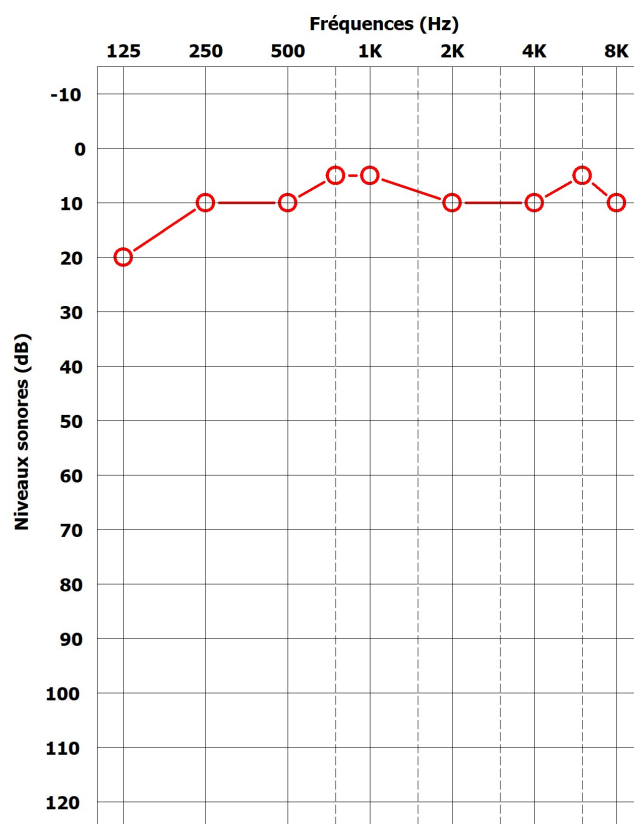

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	5	10	20	15		5		5		5
CA Droit	20	10	10	5	5		10		10	5	10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes