


MEDVIE


Date du test: 09/04/2024 16:59:56

Durée: 9mn 40s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

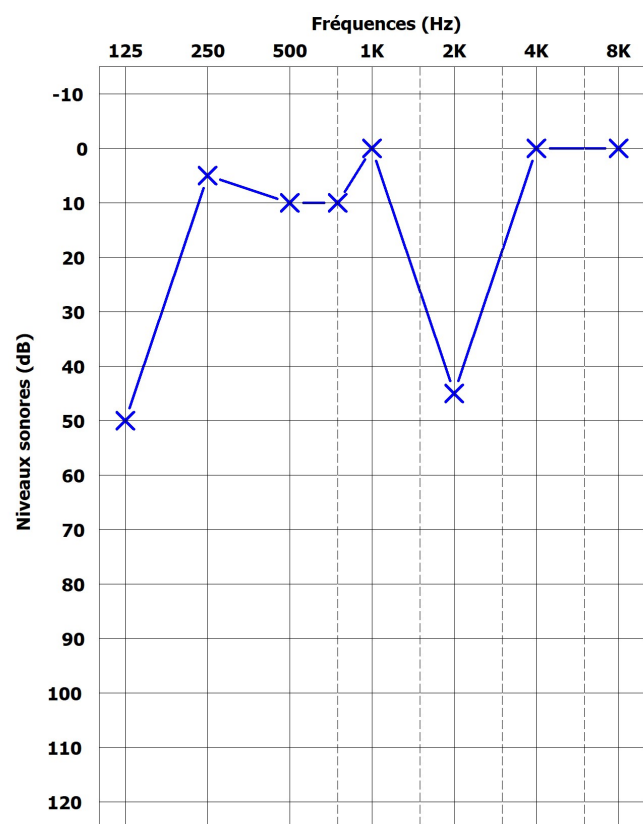

Oreille Gauche

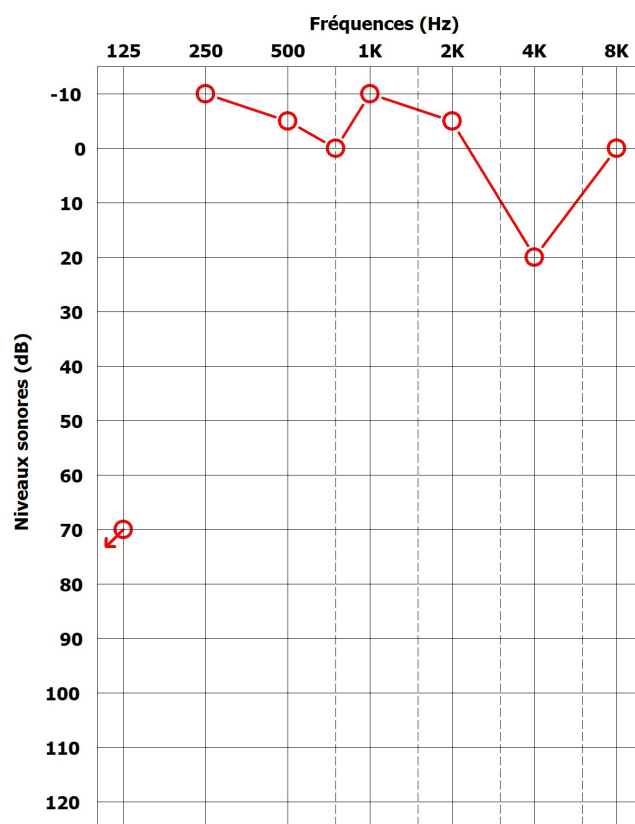

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	50	5	10	10	0		45		0		0
CA Droit	(70)	-10	-5	0	-10		-5		20		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA BANGALY
Date de naissance	06/03/1993
Age	31
Société	CR18
ID	24040916575795294

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021