


MEDVIE


Date du test: 25/08/2025 15:43:55
Durée: 3mn 33s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CISSE MOHAMED	
Date de naissance	01/01/1997
Age	28
Société	CR18
ID	25082515395631742

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

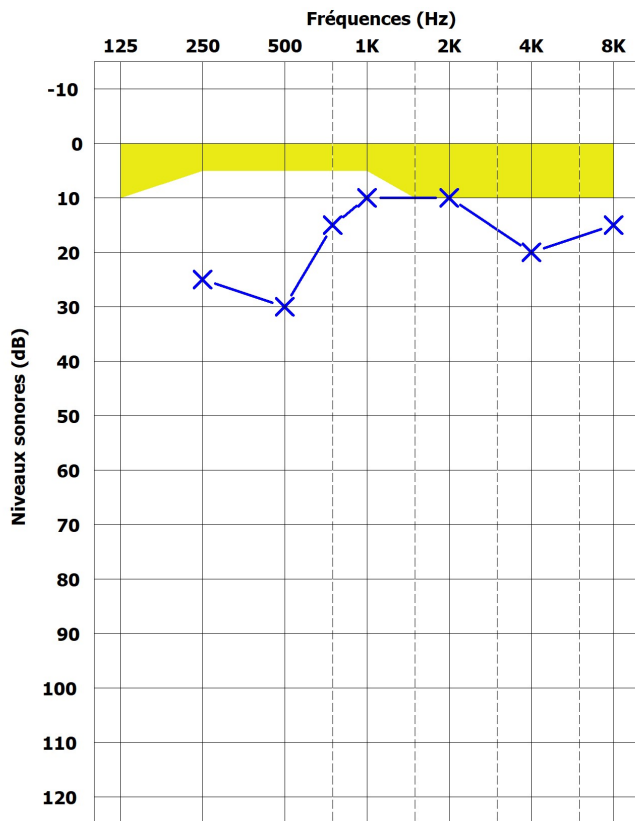

Oreille Gauche

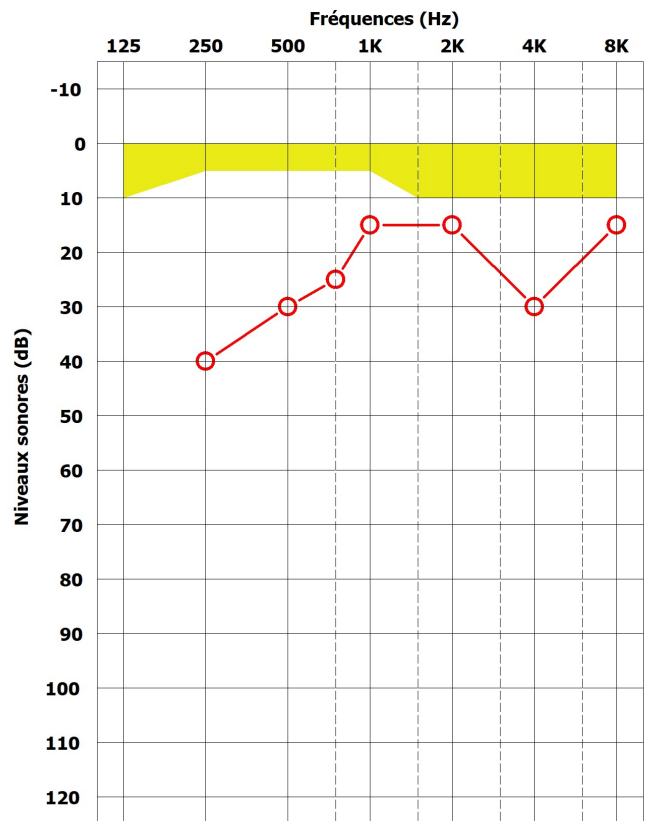

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	15	10		10		20		15
CA Droit		40	30	25	15		15		30		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes