


MEDVIE


Date du test: 28/03/2024 15:54:09
Durée: 10mn 10s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DOUMBOUYA DAOUDA	
Date de naissance	01/01/1998
Age	26
Société	CR18
ID	24032815513057413

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

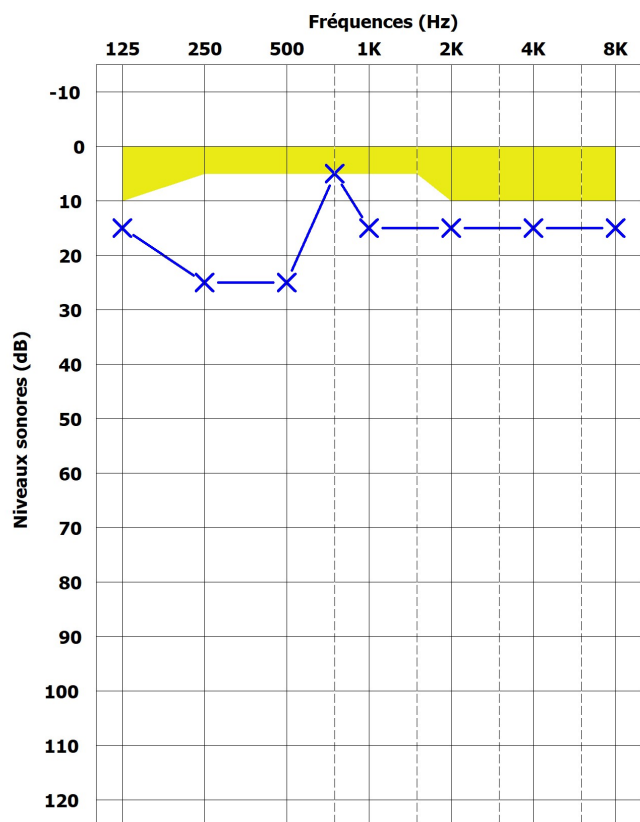

Oreille Gauche

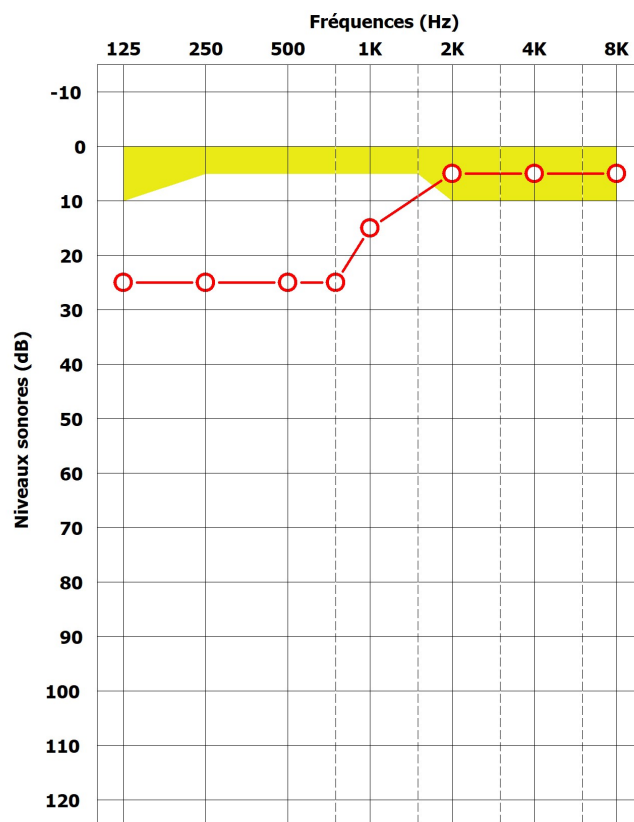

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	25	25	5	15		15		15		15
CA Droit	25	25	25	25	15		5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes