


MEDVIE BEYLA


Date du test: 12/12/2024 12:17:15

Durée: 4mn 53s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

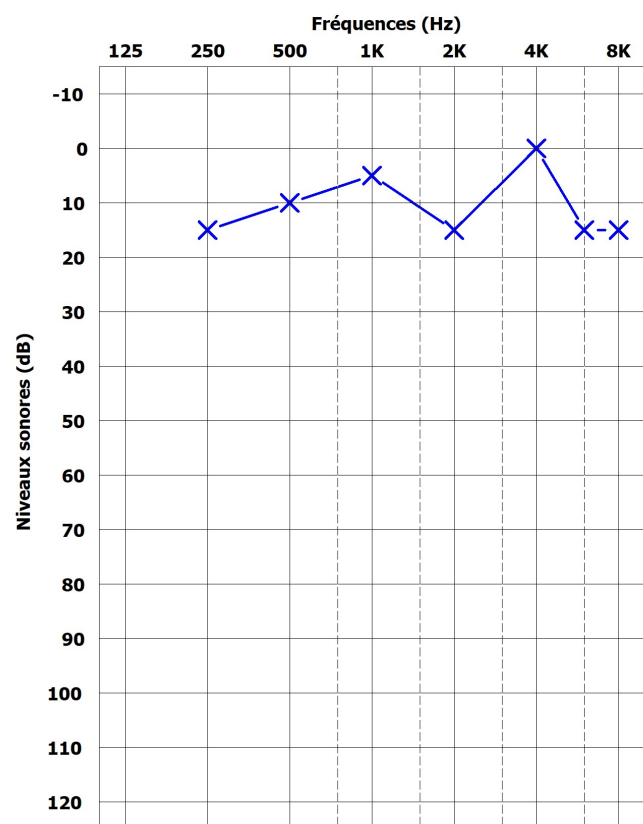

Oreille Gauche

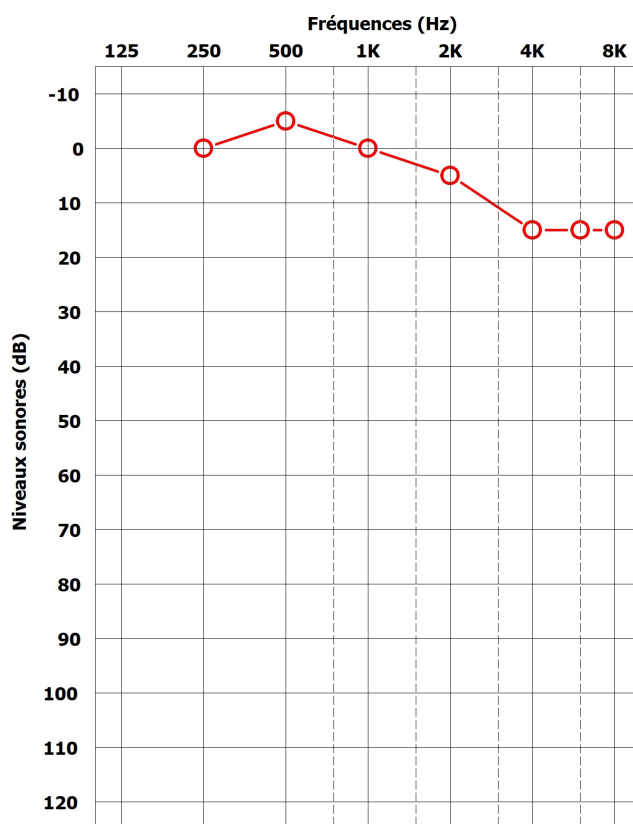

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	10		5		15		0	15	15
CA Droit		0	-5		0		5		15	15	15

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	5,0 dB
CA Droit	---	0,0 dB

Notes

Données Patient

CAMARA AMARA

Date de naissance

01/01/1992

Age

32

Société

CR18

ID

24121212064723964

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021