


MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 10:21:27
Durée: 5mn 09s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA ABOUBACAR	
Date de naissance	03/04/1994
Age	30
Société	CR18
ID	25031410192334979

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

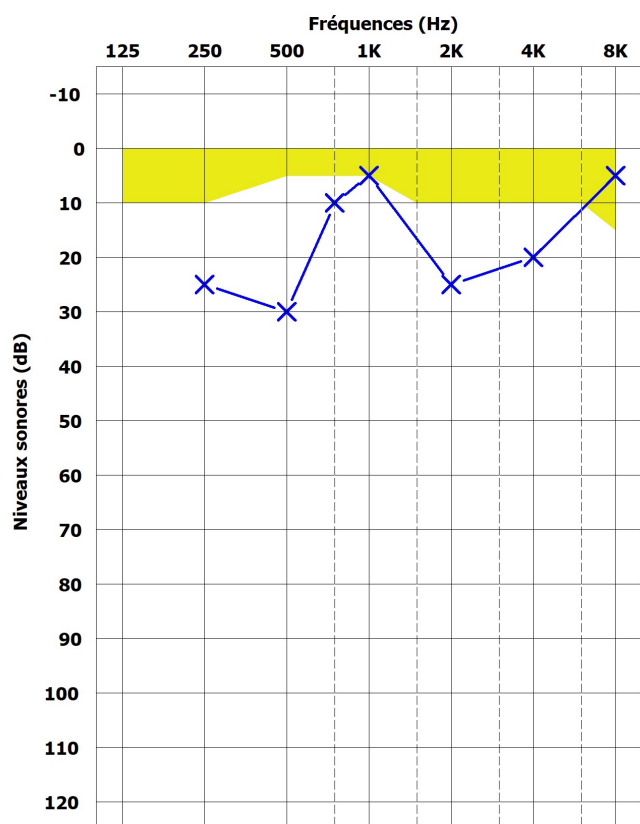

Oreille Gauche

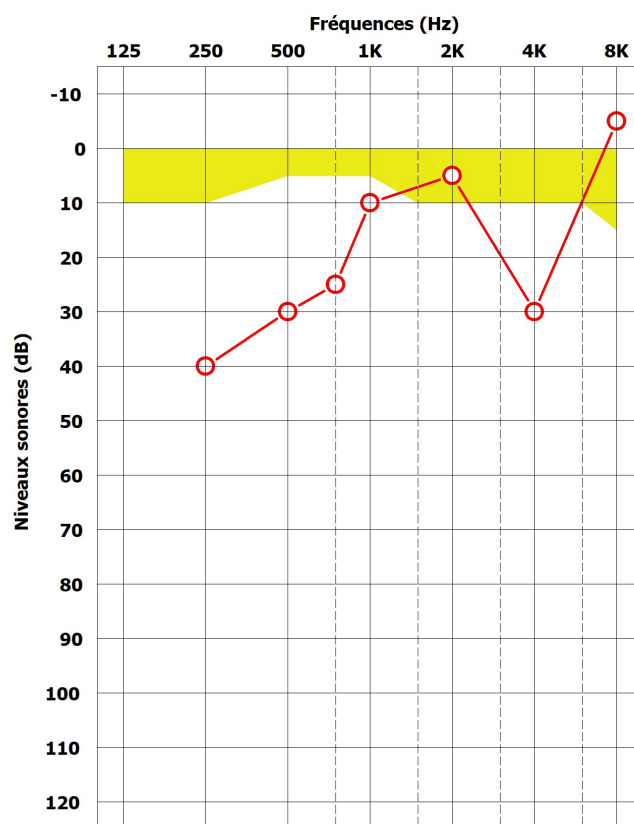

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	10	5		25		20		5
CA Droit		40	30	25	10		5		30		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes