


MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 12:03:11  
Durée: 3mn 59s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   | SACKO MOHAMED<br>I AMINE |
|-------------------|--------------------------|
| Date de naissance | 10/02/1984               |
| Age               | 41                       |
| Société           | CR18                     |
| ID                | 25031411522248494        |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690092 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

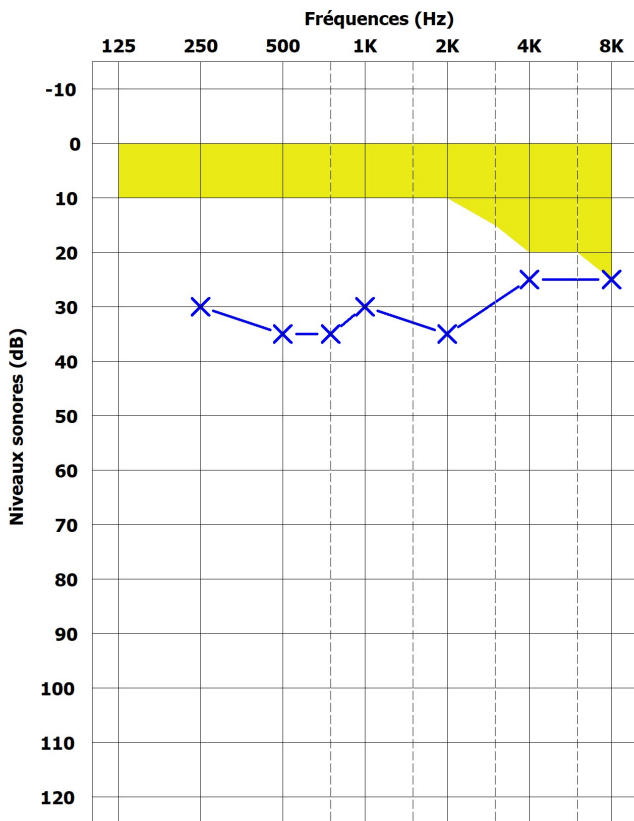

Oreille Gauche

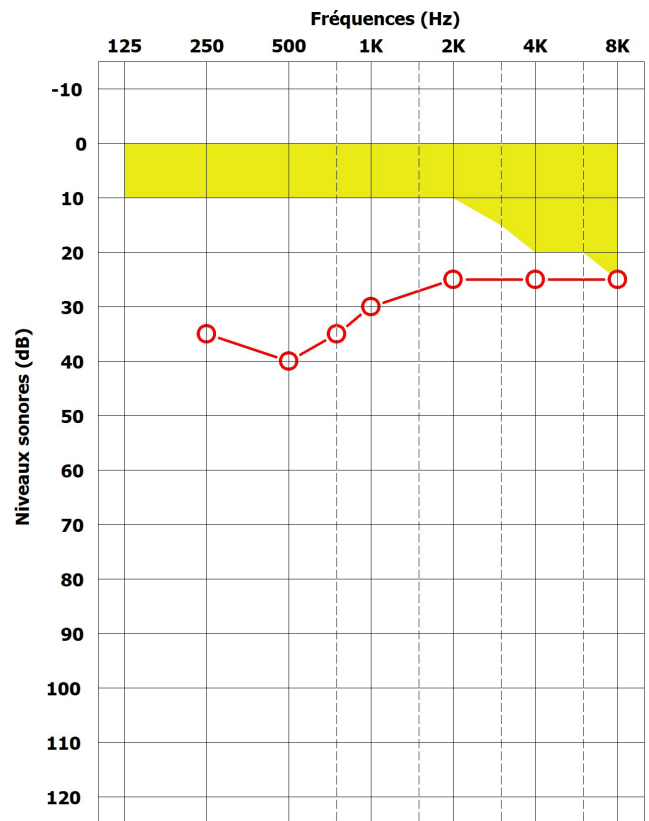

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 30  | 35  | 35  | 30 |     | 35 |    | 25 |    | 25 |
| CA Droit  |     | 35  | 40  | 35  | 30 |     | 25 |    | 25 |    | 25 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 31,3 dB | --- |
| CA Droit        | 30,0 dB | --- |

Notes