


MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 12:32:49
Durée: 6mn 22s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TRAORE SIDIKI
Date de naissance	08/10/1998
Age	26
Société	CR18
ID	25031412222998242

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

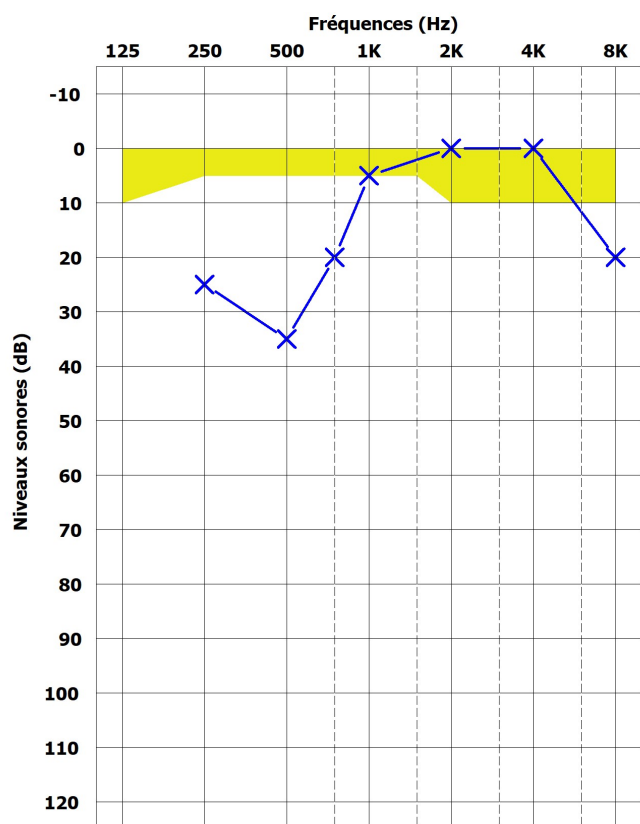

Oreille Gauche

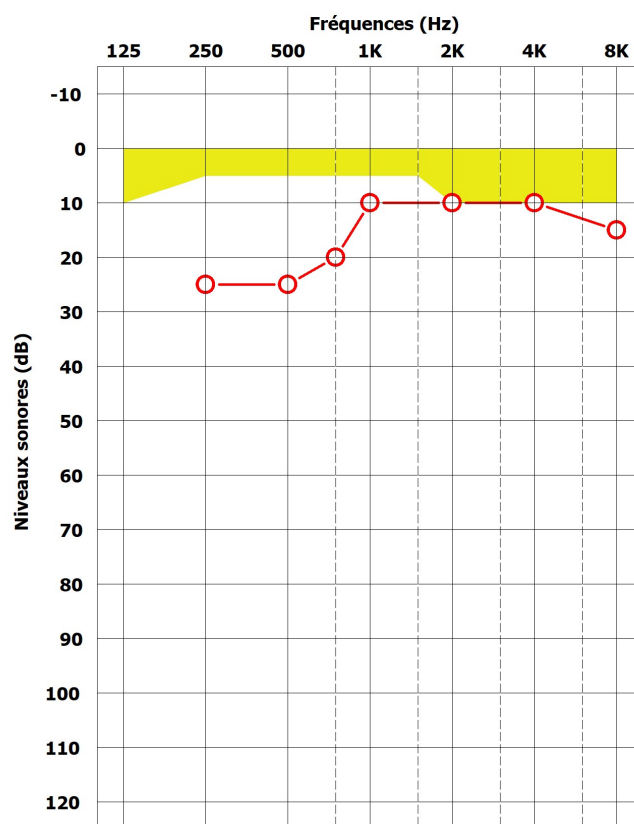

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	35	20	5		0		0		20
CA Droit		25	25	20	10		10		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes