

MEDVIE


Date du test: 24/04/2024 13:00:14

Durée: 9mn 18s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA SIDIKI	
Date de naissance	16/04/1997
Age	27
Société	CR18
ID	24042412350102928

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

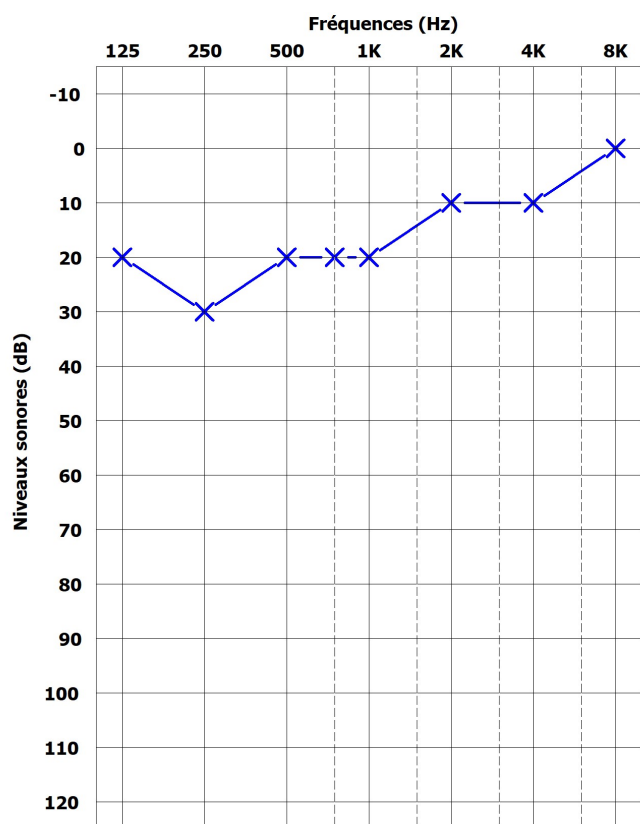

Oreille Gauche

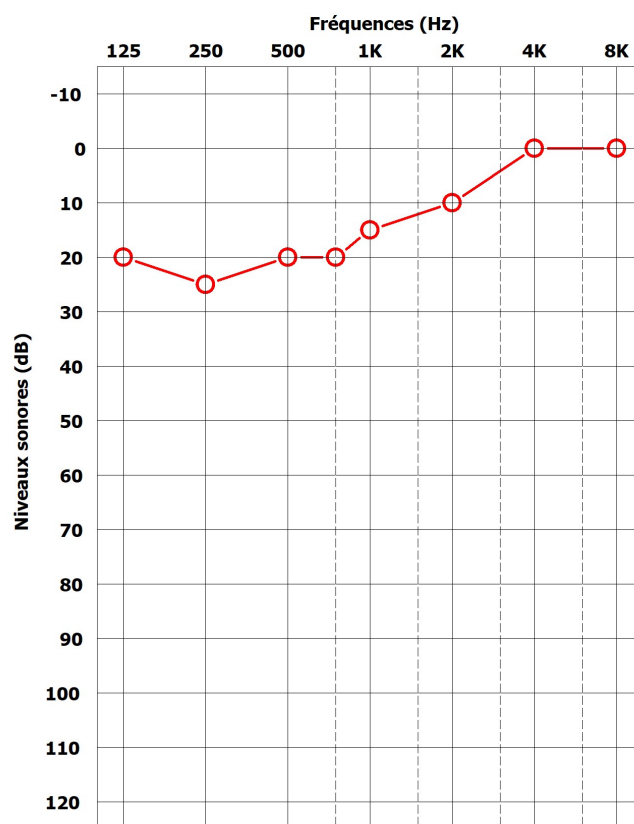

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	30	20	20	20		10		10		0
CA Droit	20	25	20	20	15		10		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes