


MEDVIE


Date du test: 01/10/2024 16:44:28
Durée: 5mn 21s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DIALLO AHMED
Date de naissance	11/08/1999
Age	25
Société	CR18
ID	24100116424101062

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

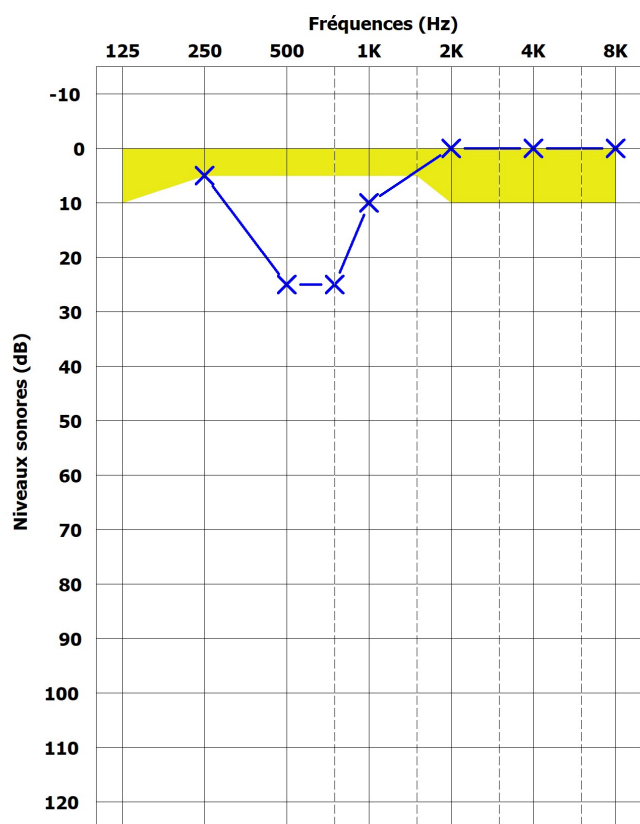

Oreille Gauche

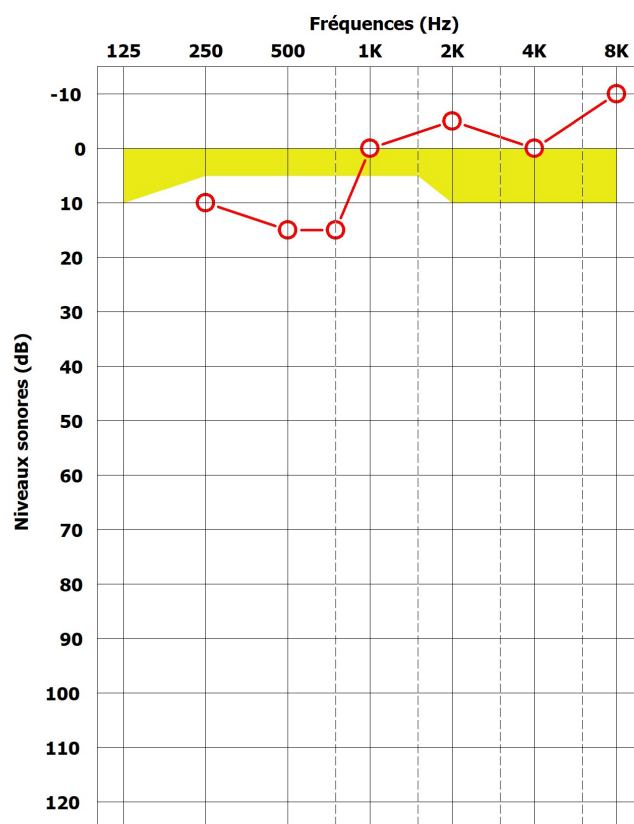

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	25	25	10		0		0		0
CA Droit		10	15	15	0		-5		0		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes