


MEDVIE


Date du test: 08/08/2025 13:52:44
Durée: 3mn 37s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA SEKOU	
Date de naissance	01/03/1998
Age	27
Société	CR18
ID	25080813501677651

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

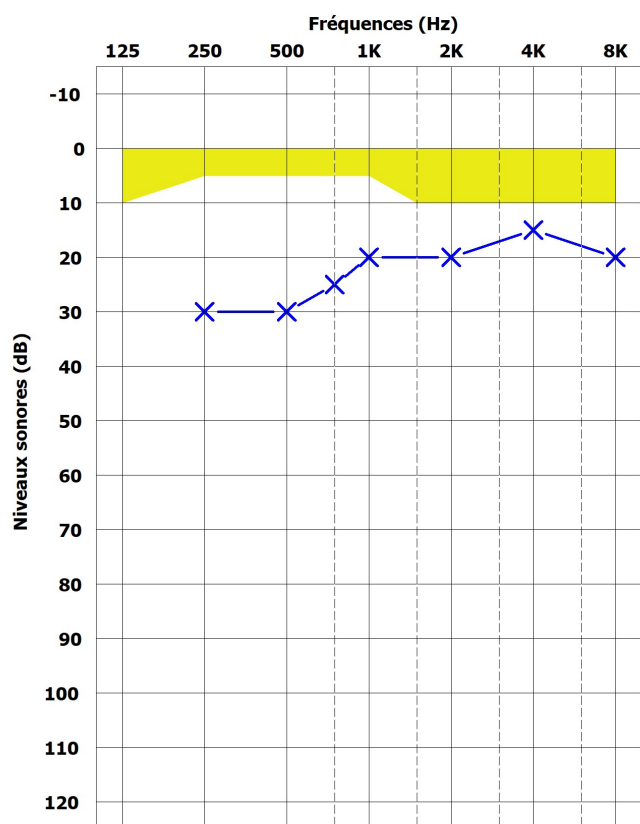

Oreille Gauche

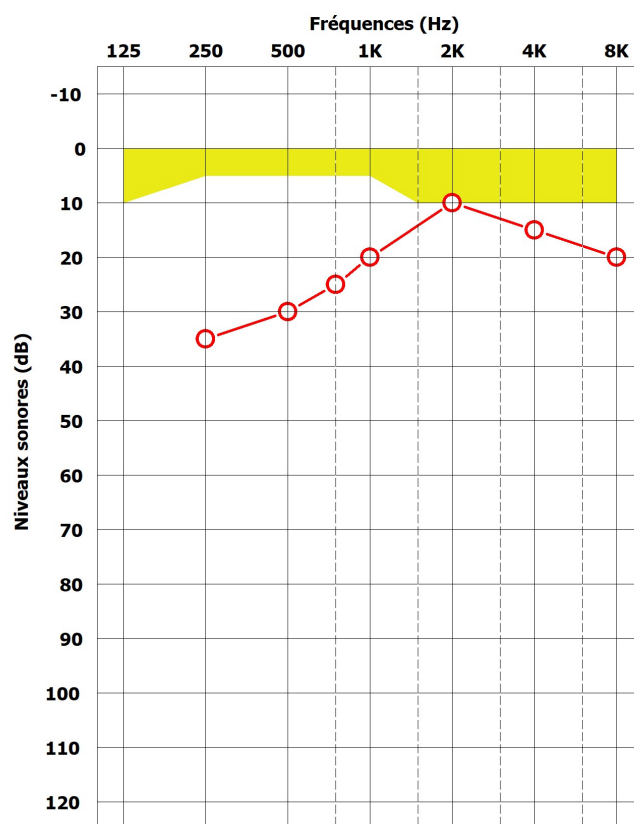

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	20		20		15		20
CA Droit		35	30	25	20		10		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes