

MEDVIE


Date du test: 15/03/2025 13:59:00

Durée: 4mn 53s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA LANSANA	
Date de naissance	01/01/1991
Age	34
Société	CR18
ID	25031513435409102

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

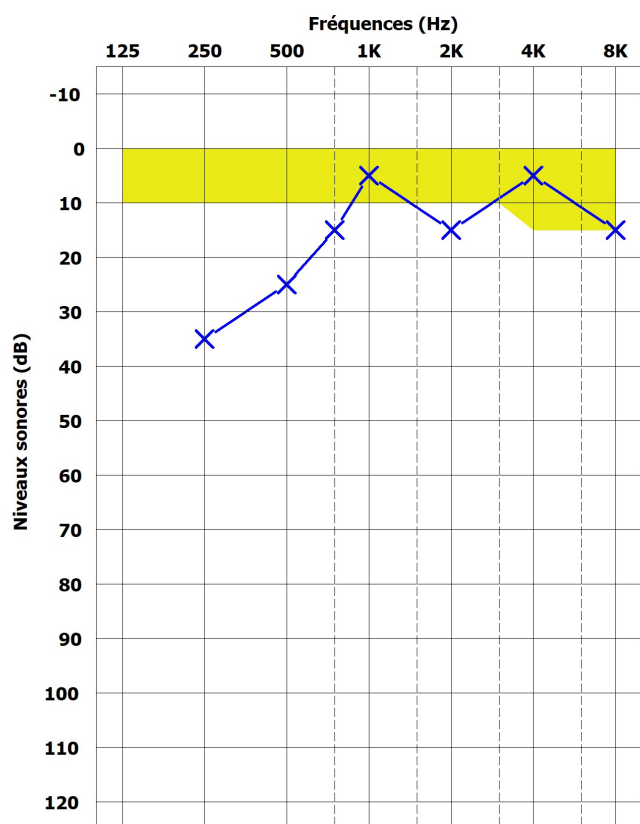

Oreille Gauche

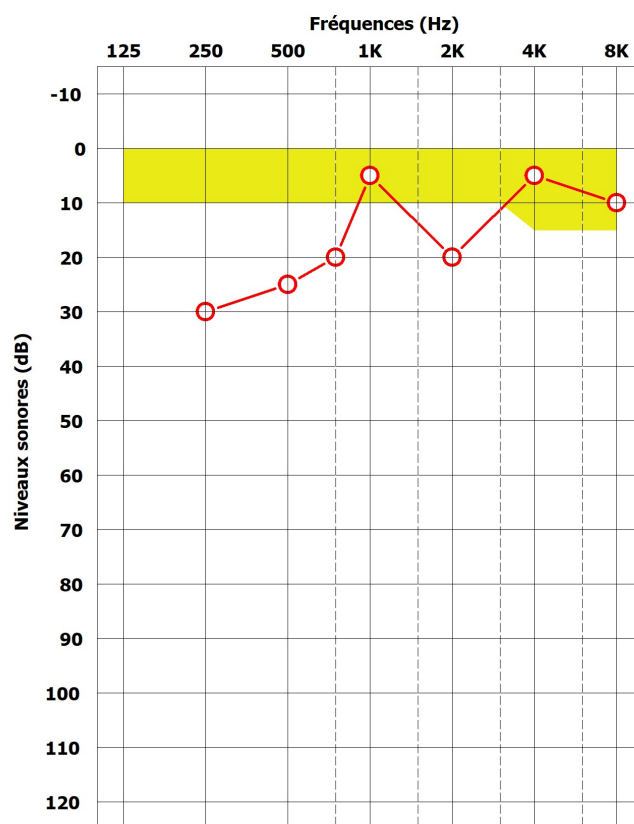

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	25	15	5		15		5		15
CA Droit		30	25	20	5		20		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes