


MEDVIE


Date du test: 20/05/2024 15:07:28
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	KONATE FAMORY
Date de naissance	03/04/2003
Age	21
Société	CR18
ID	24052015032779555

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

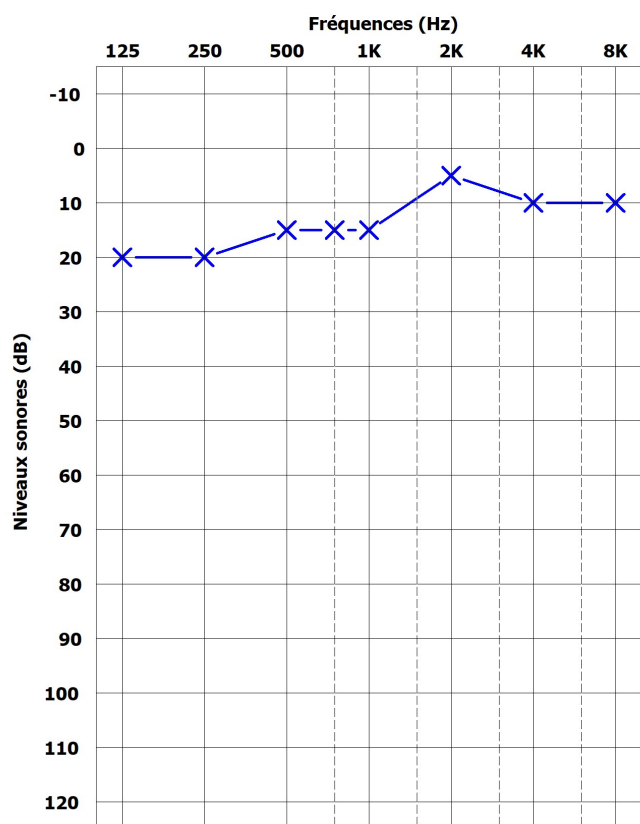

Oreille Gauche

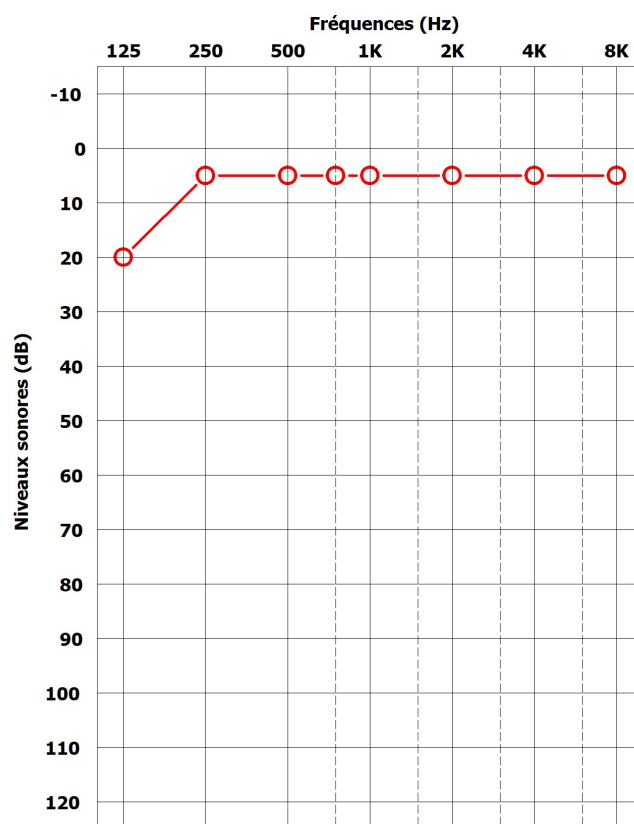

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	15	15	15		5		10		10
CA Droit	20	5	5	5	5		5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes