

MEDVIE BEYLA


Date du test: 12/12/2024 11:23:58

Durée: 4mn 25s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		DRAME MOHAMED
Date de naissance	02/01/2000	
Age	24	
Société	CR18	
ID	24121211121342565	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

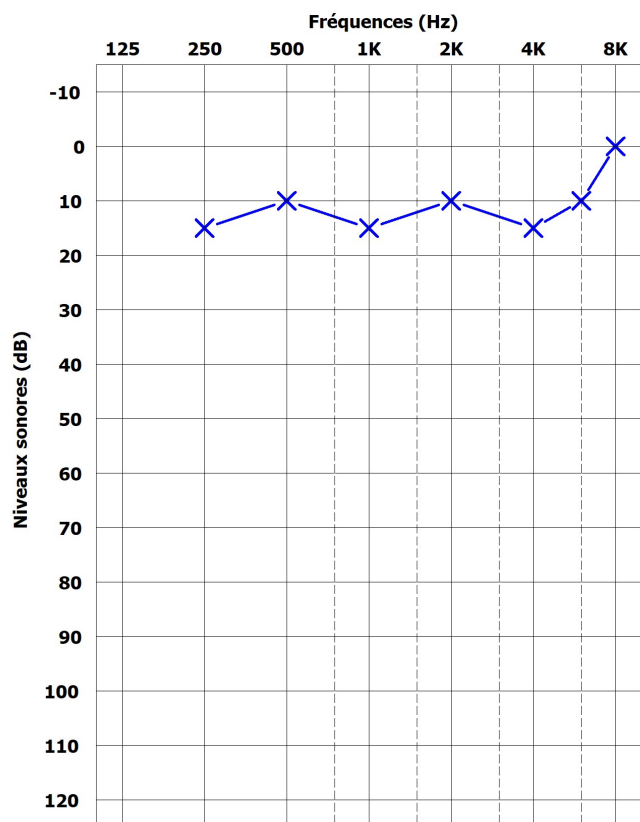

Oreille Gauche

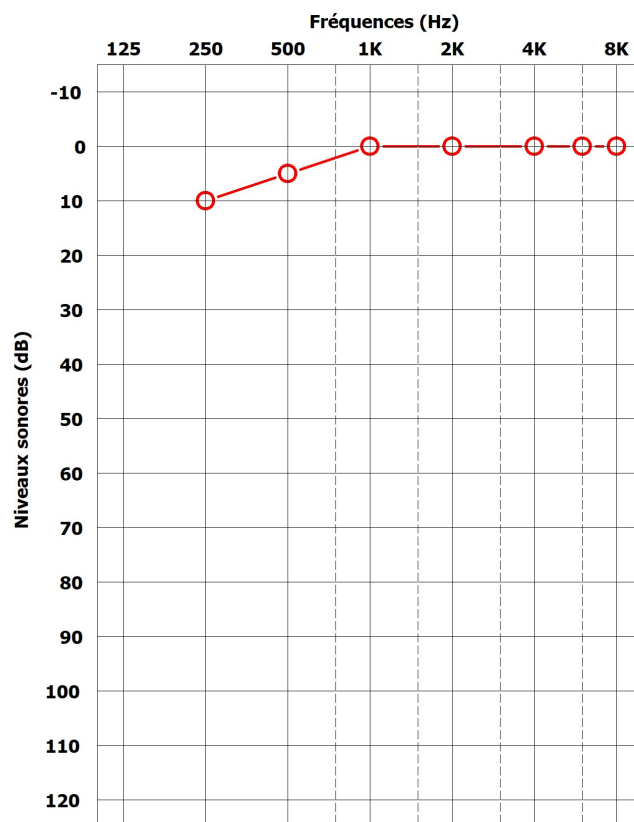

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	10		15		10		15	10	0
CA Droit		10	5		0		0		0	0	0

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	15,0 dB
CA Droit	---	0,0 dB

Notes