


MEDVIE


Date du test: 08/10/2024 14:35:42
Durée: 5mn 38s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SANKON SEINKOUN	
Date de naissance	04/10/2000
Age	24
Société	CR18
ID	24100814312516529

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

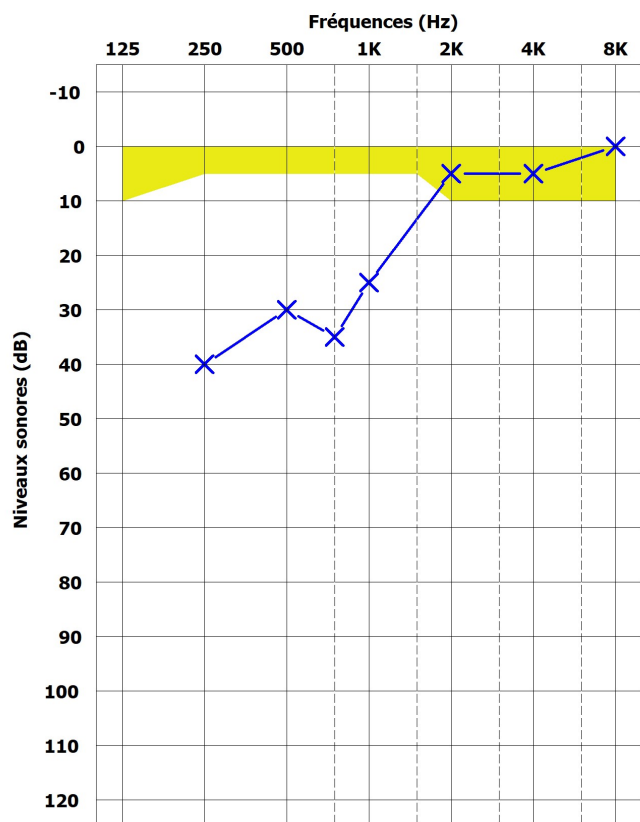

Oreille Gauche

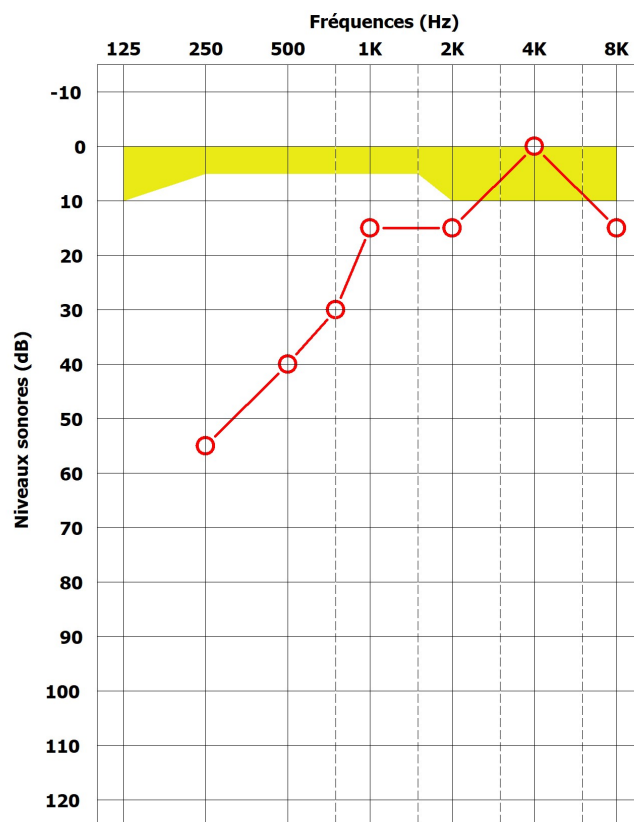

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		40	30	35	25		5		5		0
CA Droit		55	40	30	15		15		0		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes