


MEDVIE


Date du test: 18/03/2024 15:58:39
Durée: 17mn 53s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		TOURE AMARA
Date de naissance	01/01/1982	
Age	42	
Société	CR18	
ID	24031815565478527	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

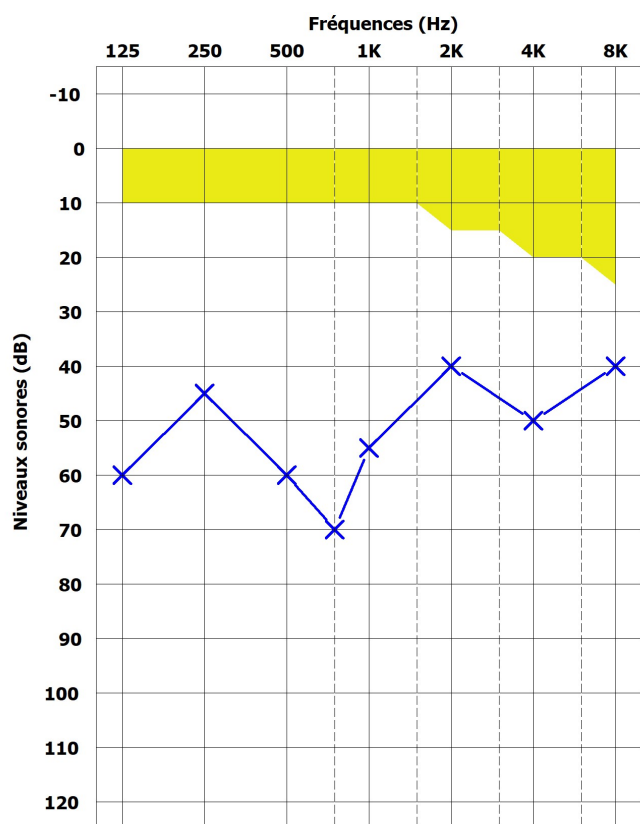

Oreille Gauche

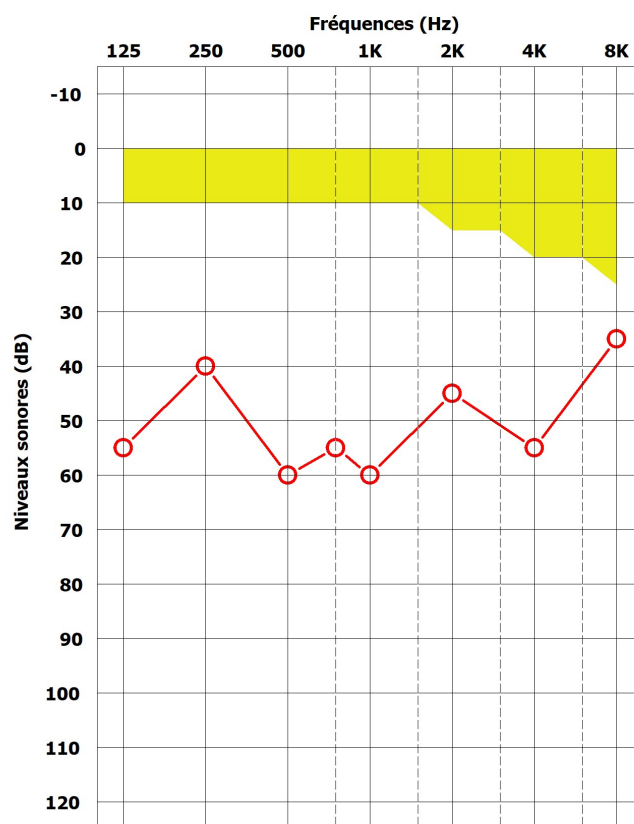

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	60	45	60	70	55		40		50		40
CA Droit	55	40	60	55	60		45		55		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	51,3 dB	---
CA Droit	55,0 dB	---

Notes