

MEDVIE


Date du test: 17/03/2025 11:34:33

Durée: 4mn 24s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO Fatoumata	
Date de naissance	01/01/1998
Age	27
Société	CR18
ID	25031711304838596

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

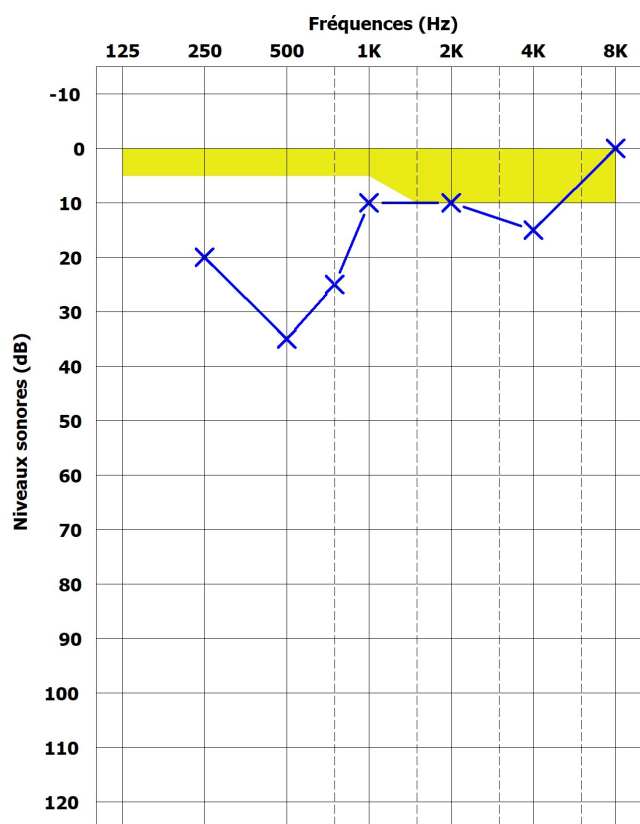

Oreille Gauche

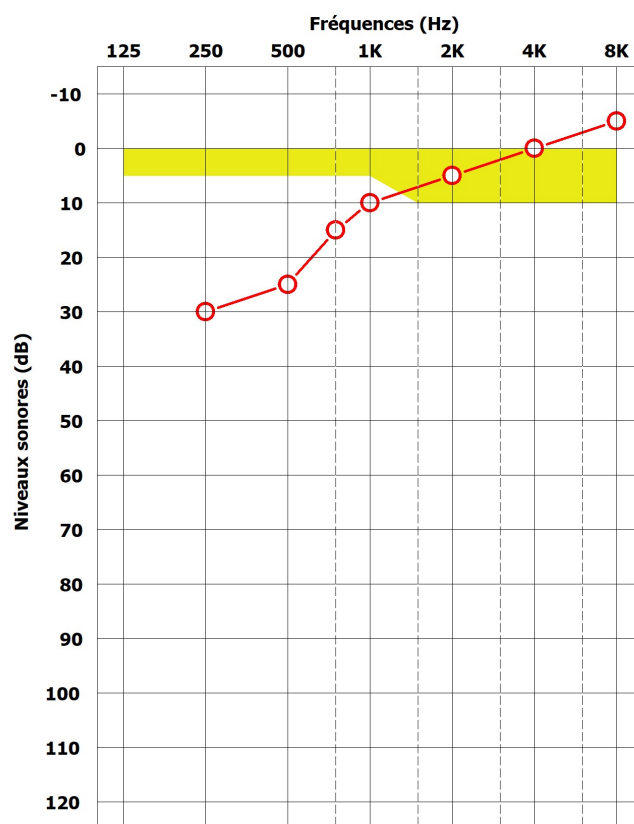

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	35	25	10		10		15		0
CA Droit		30	25	15	10		5		0		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes