


MEDVIE


Date du test: 24/05/2024 12:52:35
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	CAMARA SAMORY
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	CR18
ID	24052412491448512

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

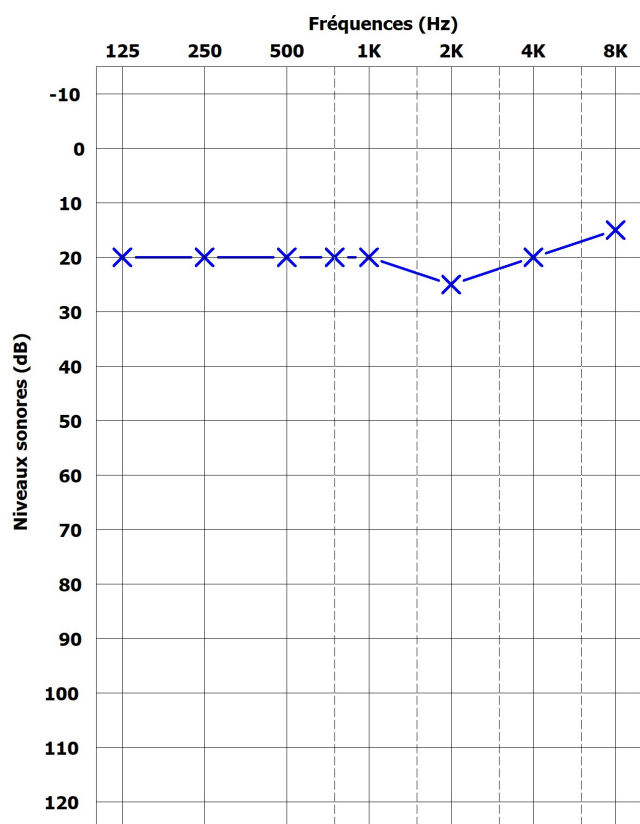

Oreille Gauche

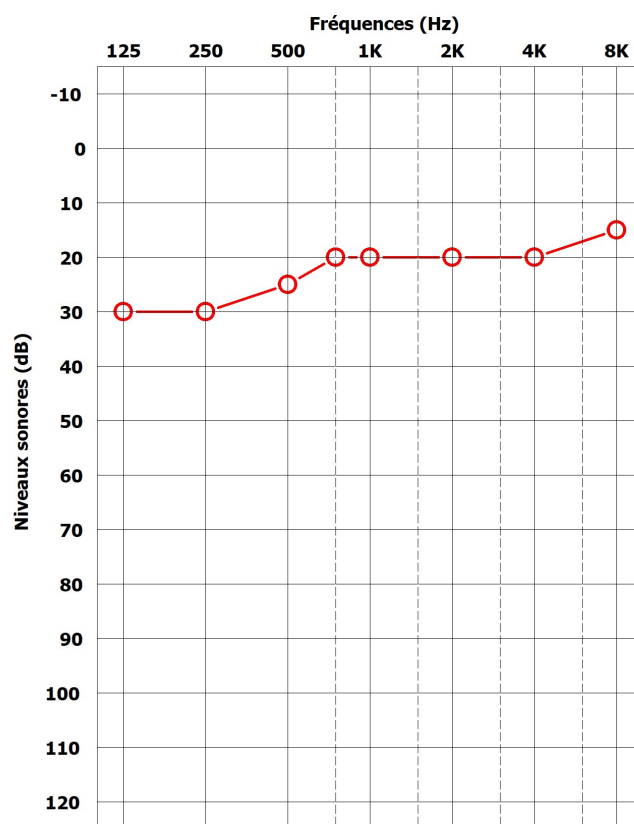

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	20	20	20		25		20		15
CA Droit	30	30	25	20	20		20		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes