


MEDVIE

Date du test: 29/09/2024 17:31:42

Durée: 5mn 06s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

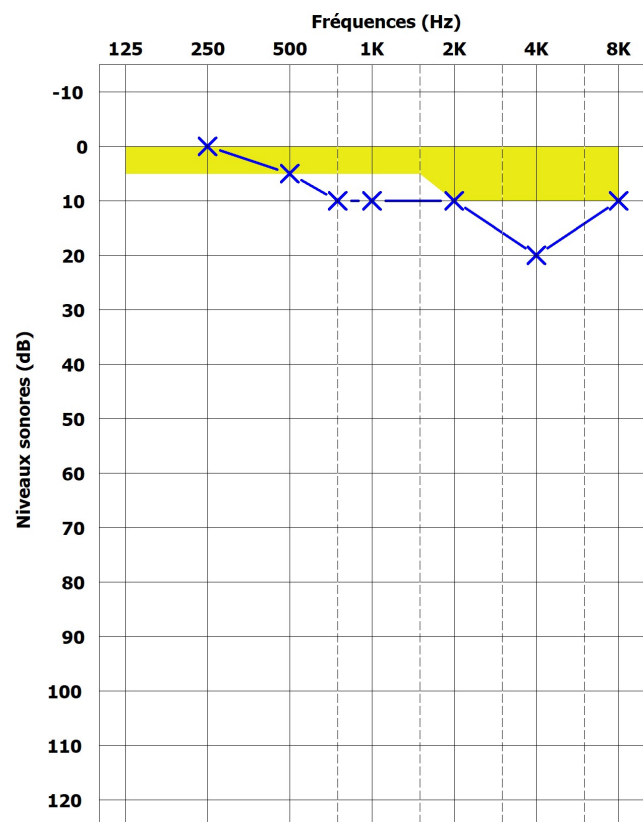

Oreille Gauche

Données Patient	
FOFANA KARAMO	
Date de naissance	01/01/2002
Age	22
Société	CR18
ID	24092917120256529

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

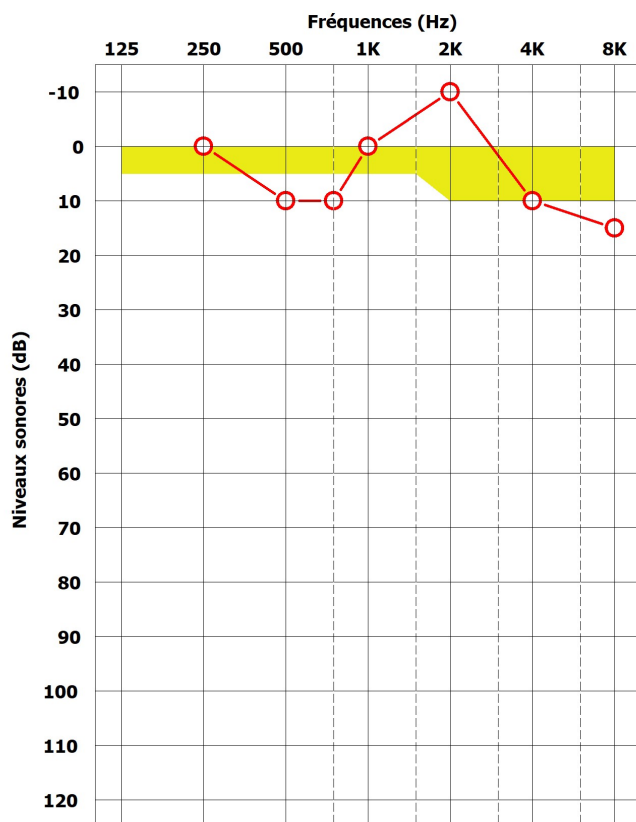

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	5	10	10		10		20		10
CA Droit		0	10	10	0		-10		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes