


MEDVIE


Date du test: 29/09/2024 20:05:46

Durée: 6mn 28s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

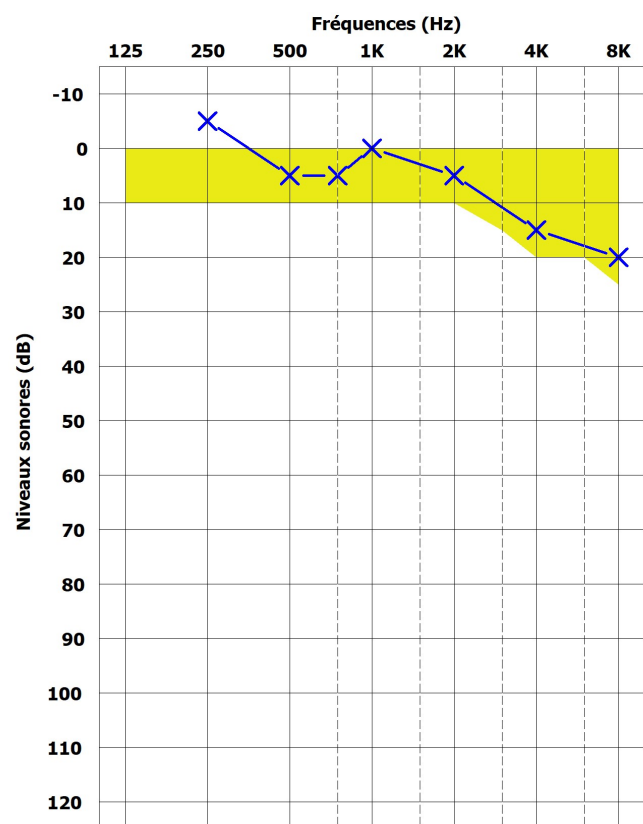

Oreille Gauche

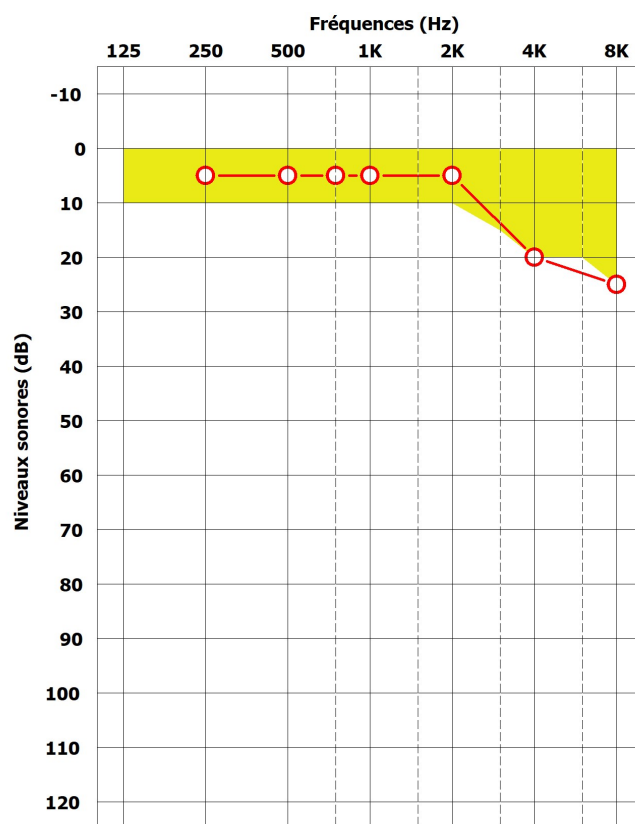

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	5	5	0		5		15		20
CA Droit		5	5	5	5		5		20		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes

Données Patient

CAMARA SEYDOU

Date de naissance

01/01/1984

Age

40

Société

CR18

ID

24092919525686294

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021