

MEDVIE


Date du test: 18/03/2025 12:30:27

Durée: 4mn 10s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	ZHANG JING
Date de naissance	21/05/1971
Age	53
Société	CR18
ID	25031812290403638

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

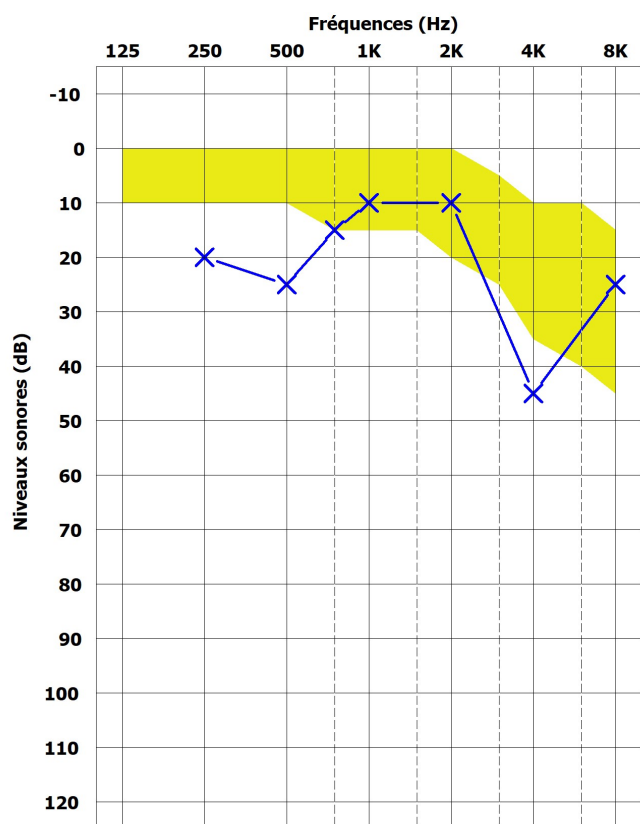

Oreille Gauche

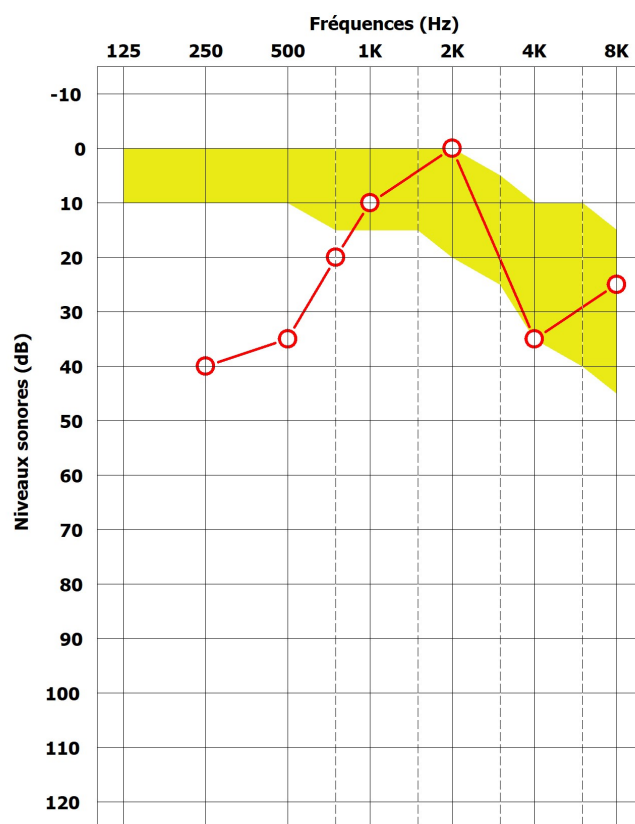

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	15	10		10		45		25
CA Droit		40	35	20	10		0		35		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes