


MEDVIE


Date du test: 29/07/2025 16:37:43
Durée: 3mn 33s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KOMARA SOUMAILA
Date de naissance	15/04/2002
Age	23
Société	CR18
ID	25072916352605509

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

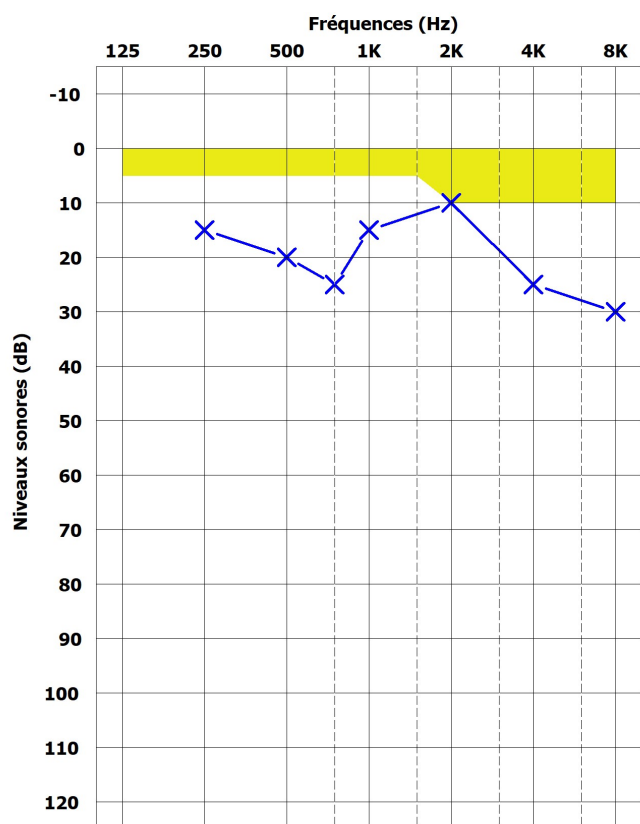

Oreille Gauche

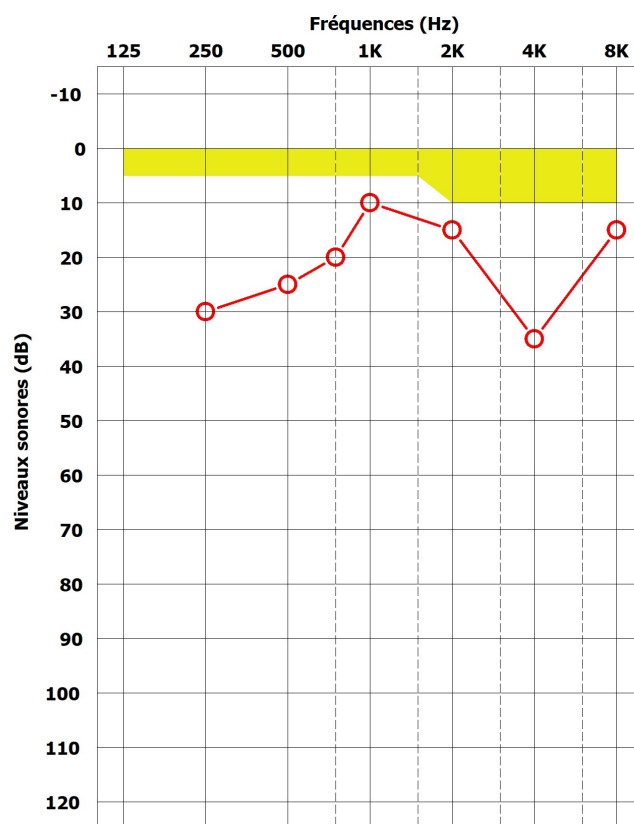

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	25	15		10		25		30
CA Droit		30	25	20	10		15		35		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes