


MEDVIE


Date du test: 01/10/2024 14:12:37

Durée: 4mn 39s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

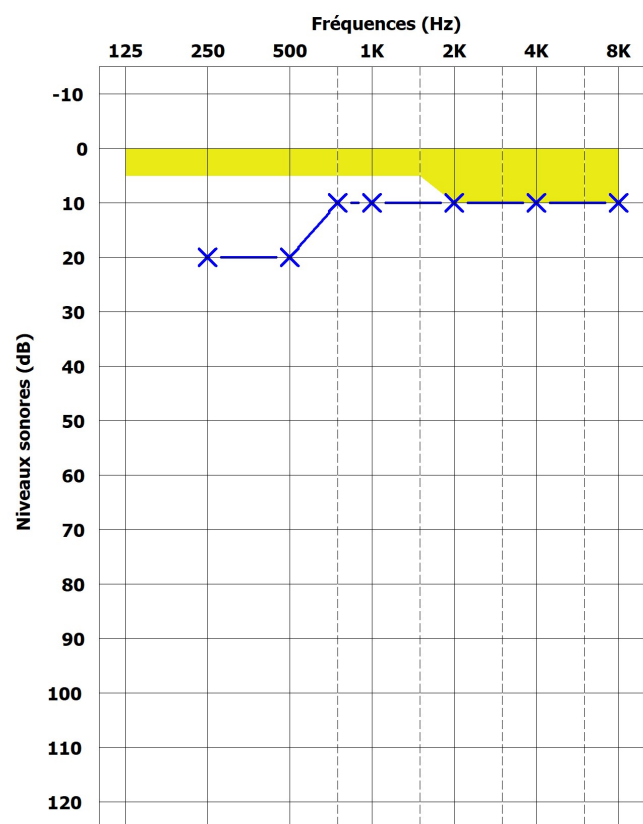

Oreille Gauche

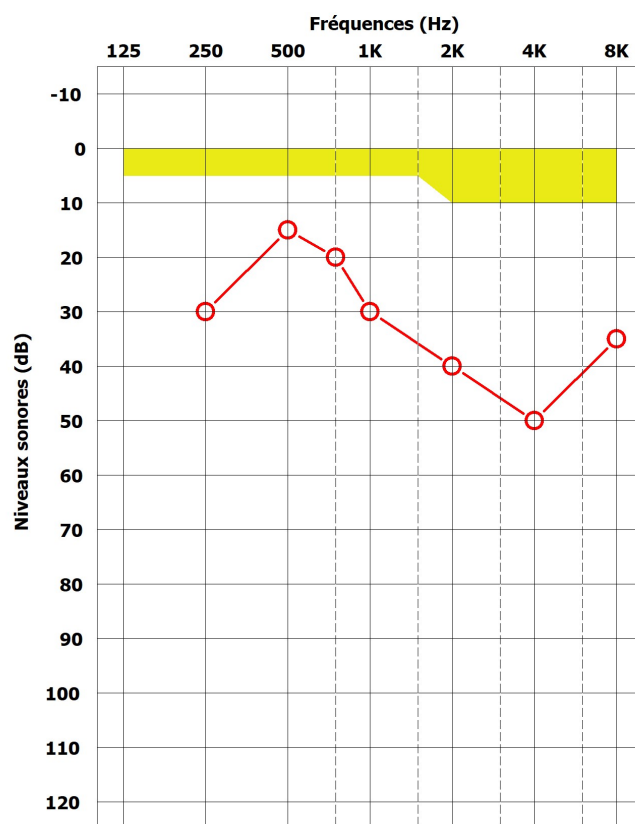

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	10	10		10		10		10
CA Droit		30	15	20	30		40		50		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	33,8 dB	---

Notes

Données Patient	DIALLO AMADOU MOICTAR
Date de naissance	16/06/2001
Age	23
Société	CR18
ID	24100114014695758

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021