

MEDVIE


Date du test: 29/02/2024 13:51:20

Durée: 7mn 25s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA SEKOU OUMAR
Date de naissance	15/12/1988
Age	35
Société	CR18
ID	24022913473594601

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

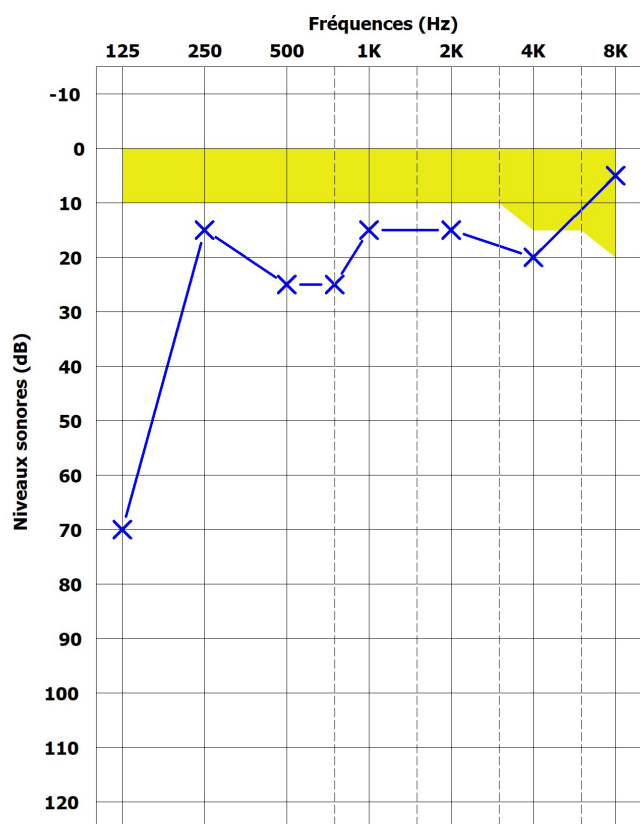

Oreille Gauche

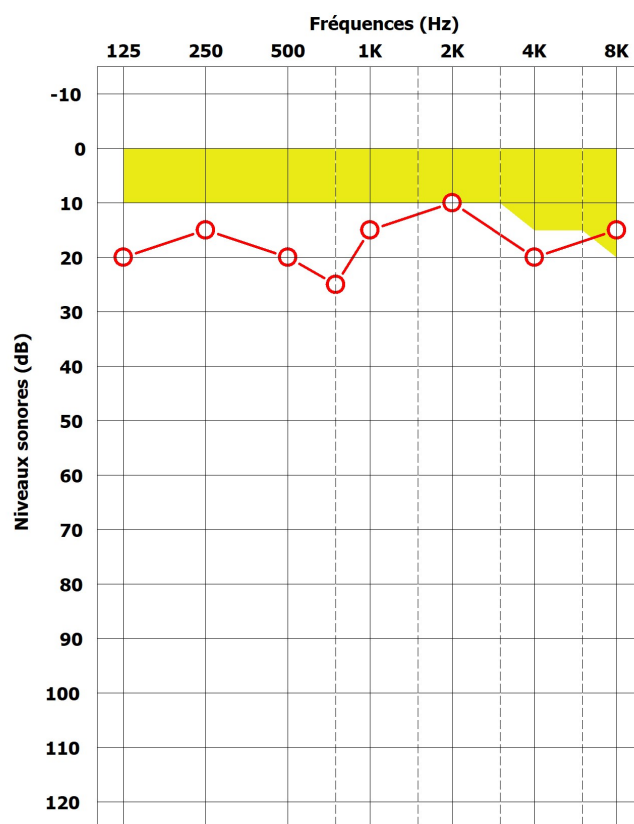

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	70	15	25	25	15		15		20		5
CA Droit	20	15	20	25	15		10		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes