

Données Patient

TRAORE MOUSSA

Date de naissance

01/01/2000

Age

24

Société

CR18

ID

24050414364569864

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :


30/11/2021

Date du test: 04/05/2024 14:40:46


Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

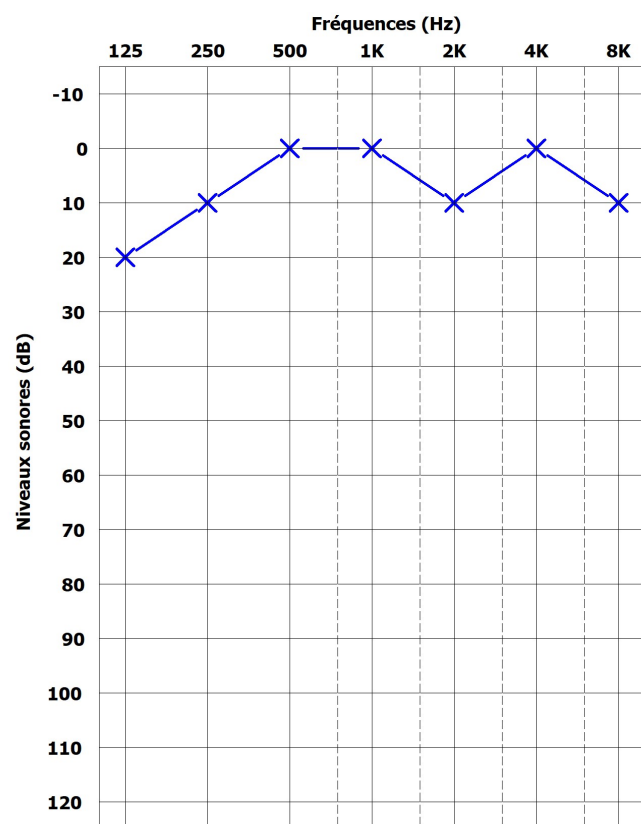

Oreille Gauche

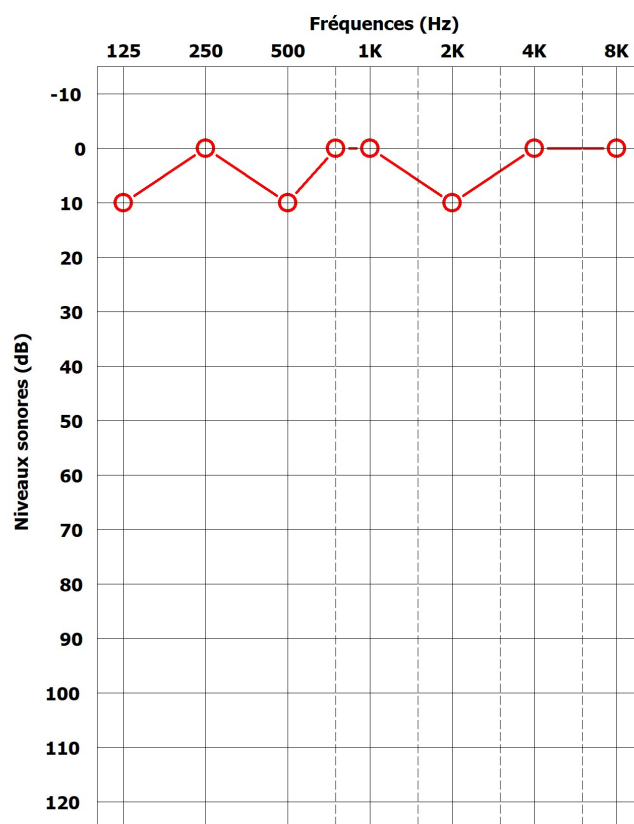

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	10	0		0		10		0		10
CA Droit	10	0	10	0	0		10		0		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes