


MEDVIE


Date du test: 18/03/2024 14:20:24
Durée: 9mn 14s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CHERIF VAFING
Date de naissance	01/01/1985	
Age	39	
Société	CR18	
ID	24031814172070100	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

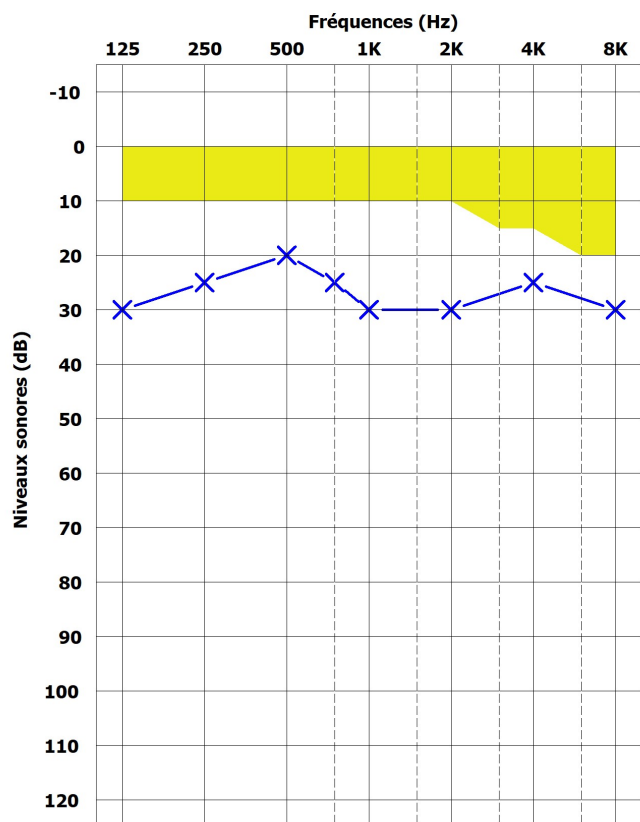

Oreille Gauche

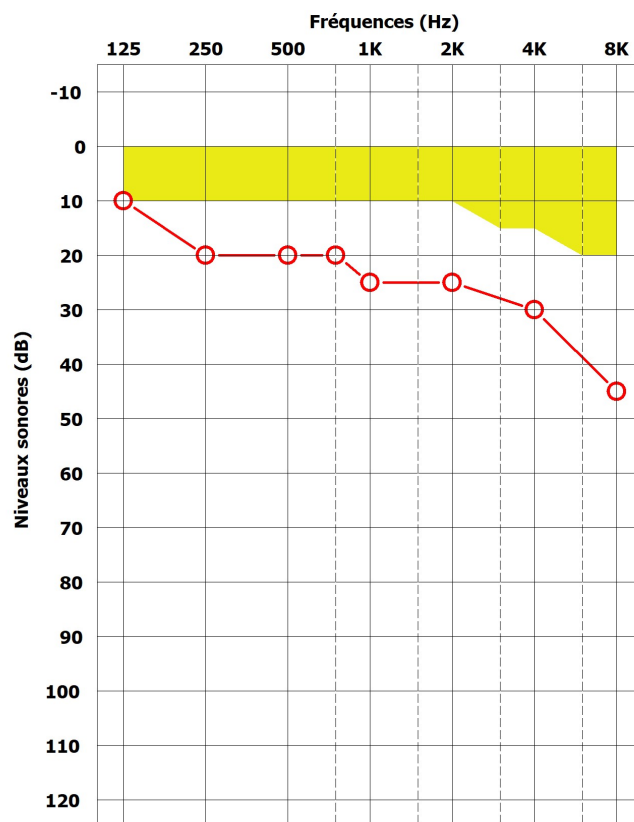

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	25	20	25	30		30		25		30
CA Droit	10	20	20	20	25		25		30		45

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes