

MEDVIE


Date du test: 10/03/2025 12:13:47

Durée: 5mn 54s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KOUROUMA SIAKA
Date de naissance	16/06/1994
Age	30
Société	CR18
ID	25031012053976405

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

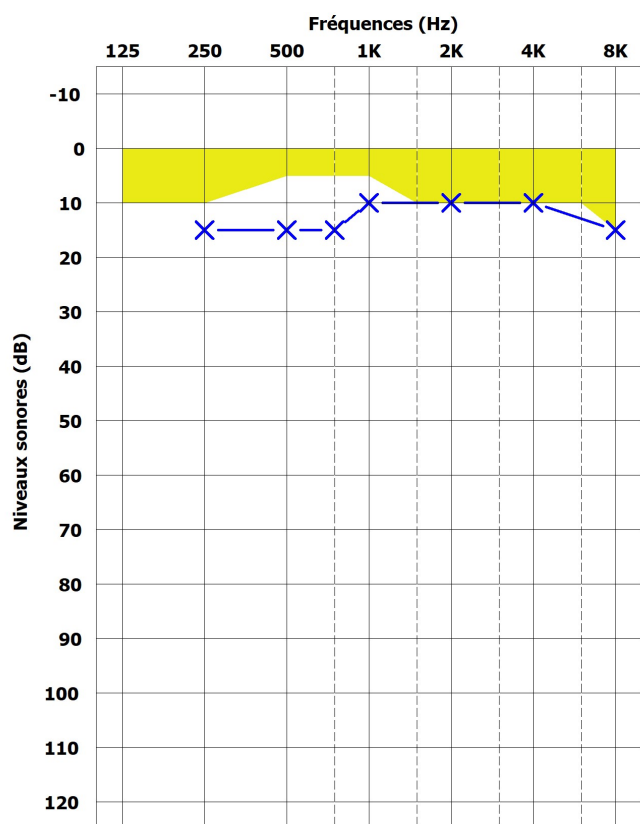

Oreille Gauche

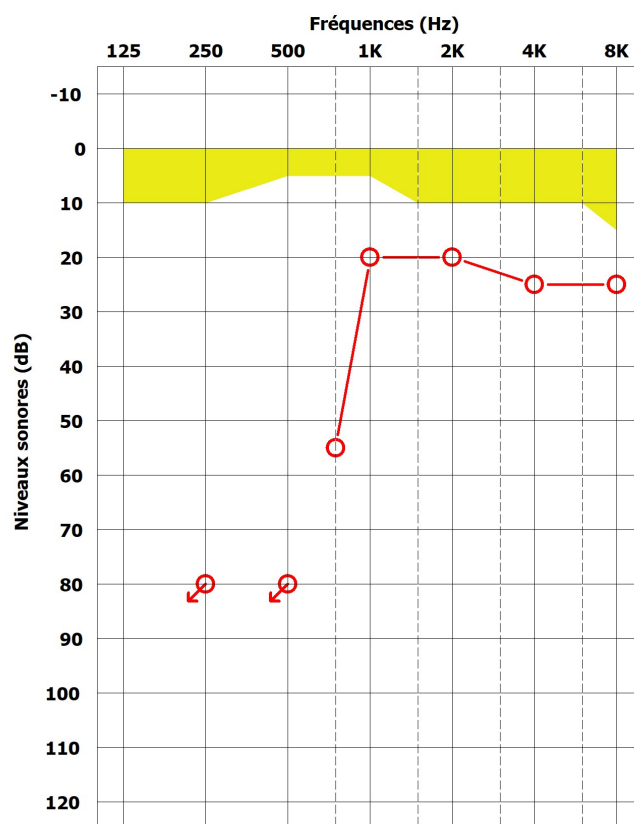

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	15	10		10		10		15
CA Droit		(80)	(80)	55	20		20		25		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	---	---

Notes