

MEDVIE


Date du test: 08/03/2025 11:10:17

Durée: 4mn 13s


Type test
 Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Données Patient	SIMAGAN Souleymane
Date de naissance	12/07/1983
Age	41
Société	CR18
ID	25030811075564301

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

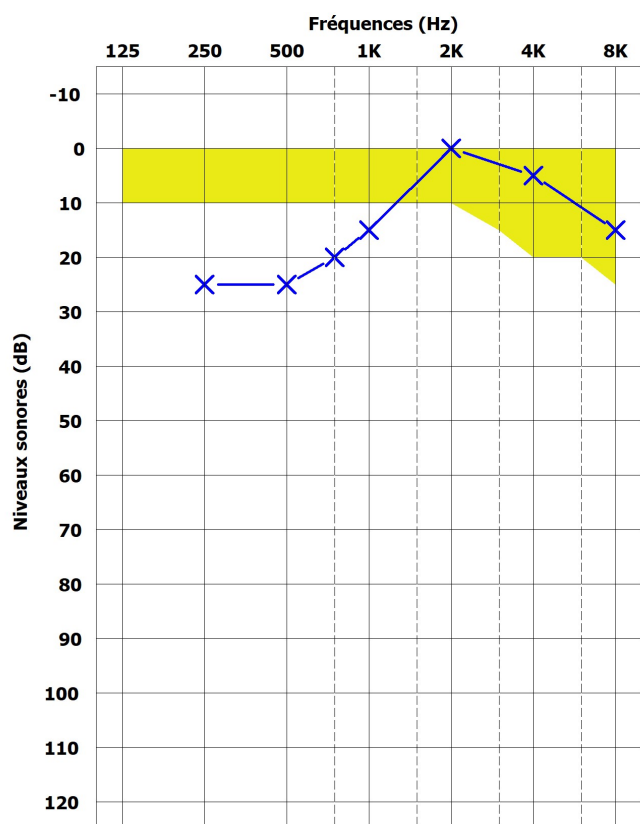

Oreille Gauche

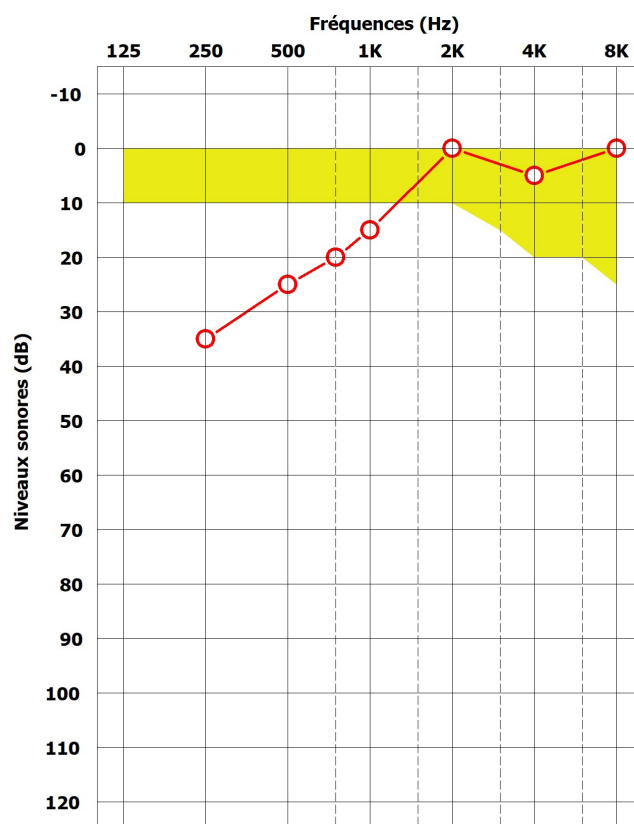

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	20	15		0		5		15
CA Droit		35	25	20	15		0		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes