


MEDVIE


Date du test: 07/03/2025 12:17:21
Durée: 6mn 07s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA SEKOU 2	
Date de naissance	05/01/1990
Age	35
Société	CR18
ID	25030711122433178

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

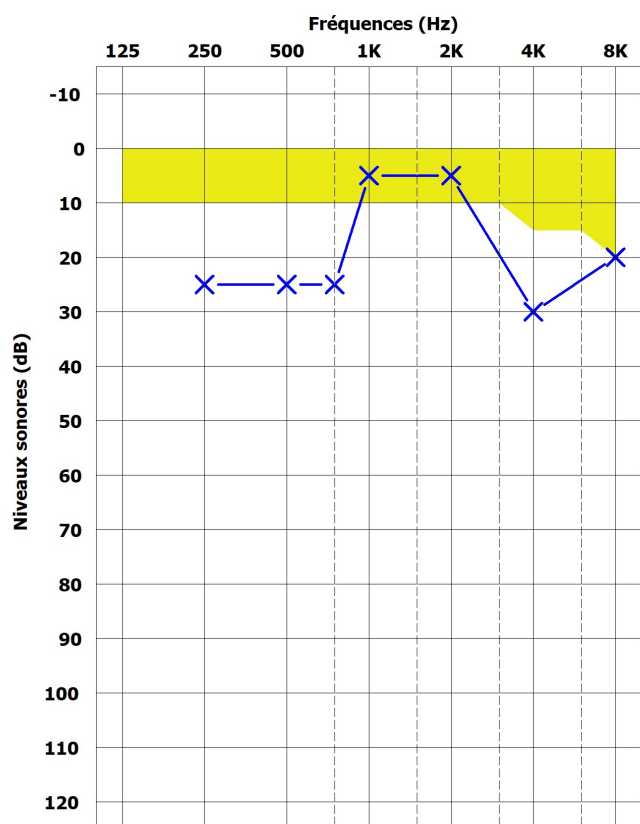

Oreille Gauche

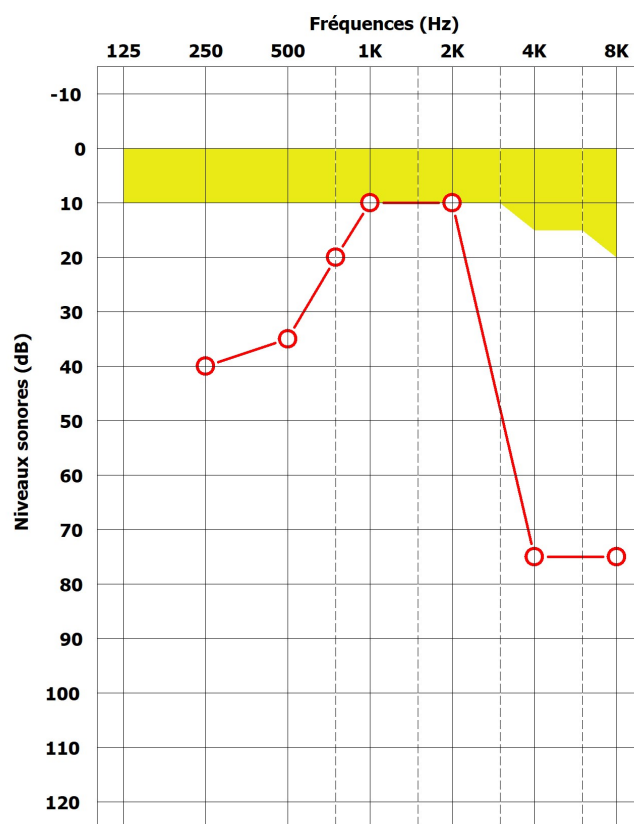

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	25	5		5		30		20
CA Droit		40	35	20	10		10		75		75

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	32,5 dB	---

Notes