


MEDVIE


Date du test: 02/05/2024 11:09:49

Durée: 8mn 02s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

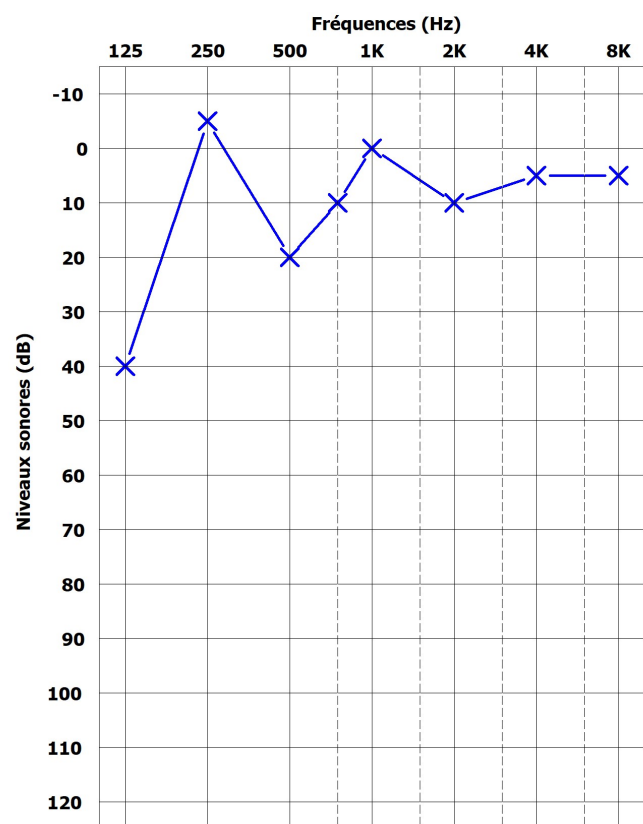

Oreille Gauche

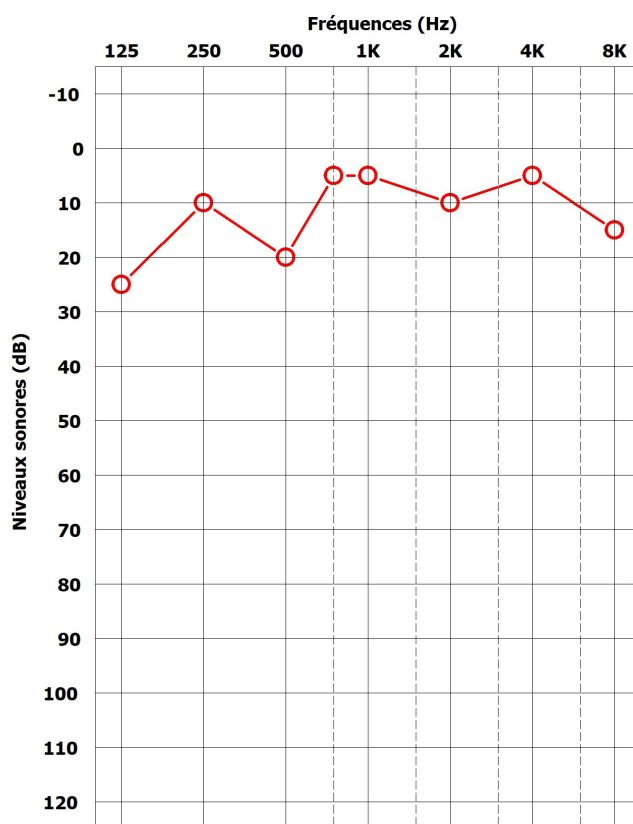

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	-5	20	10	0		10		5		5
CA Droit	25	10	20	5	5		10		5		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA MORY
Date de naissance	01/01/1993
Age	31
Société	CR18
ID	24050211055191614

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021