

MEDVIE


Date du test: 29/04/2024 16:29:27

Durée: 10mn 21s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   |
|-------------------|-------------------|
| SOUMAORO MOHAMED  |                   |
| Date de naissance | 02/07/2000        |
| Age               | 23                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 24042916254105453 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

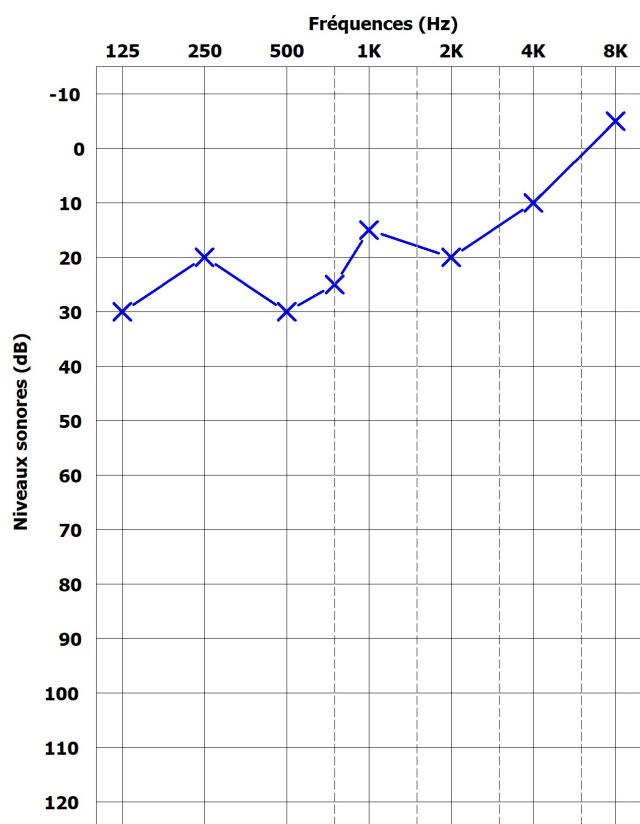

Oreille Gauche

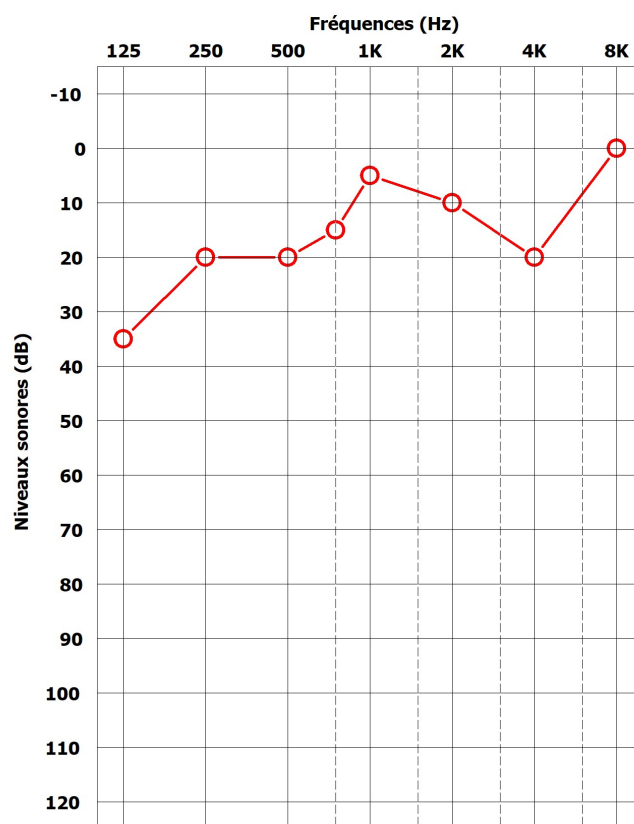

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 30  | 20  | 30  | 25  | 15 |     | 20 |    | 10 |    | -5 |
| CA Droit  | 35  | 20  | 20  | 15  | 5  |     | 10 |    | 20 |    | 0  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 18,8 dB | --- |
| CA Droit        | 13,8 dB | --- |

Notes