


MEDVIE


Date du test: 05/07/2025 12:33:11
Durée: 4mn 39s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
LINAG XUEFENG	
Date de naissance	08/10/1977
Age	47
Société	CR18
ID	25070512284240755

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

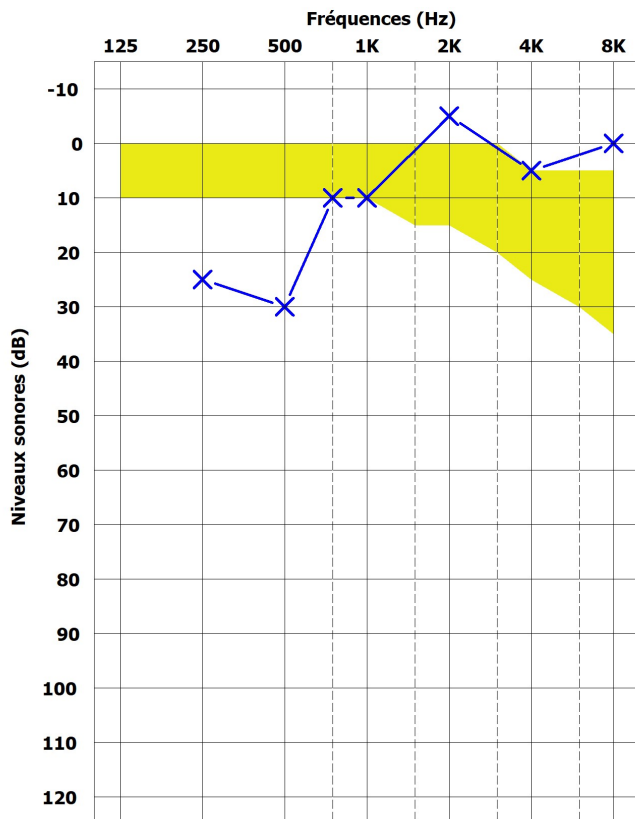

Oreille Gauche

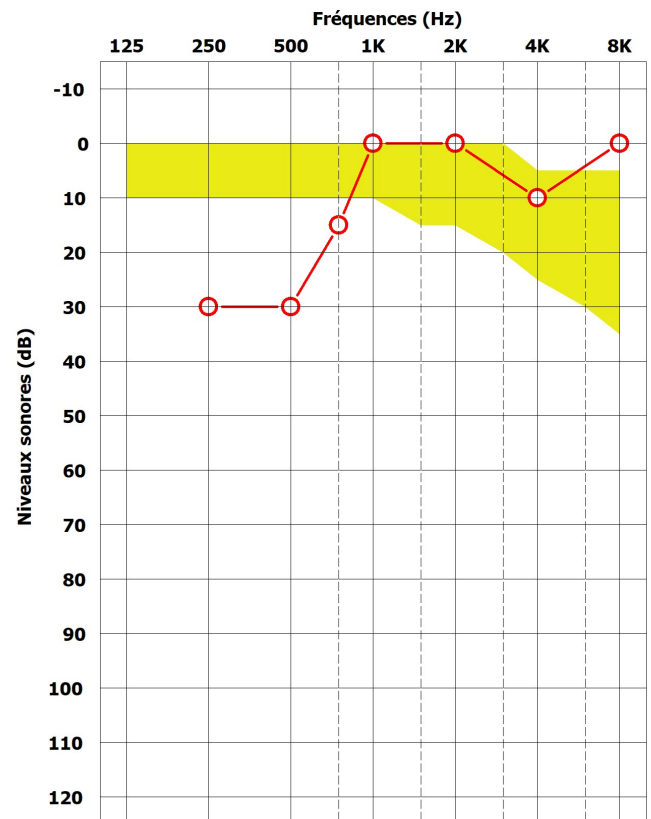

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	10	10		-5		5		0
CA Droit		30	30	15	0		0		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes