

MEDVIE


Date du test: 12/03/2025 11:52:42

Durée: 7mn 00s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	XING YANCHAO
Date de naissance	05/10/1981
Age	43
Société	CR18
ID	25031211493917343

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

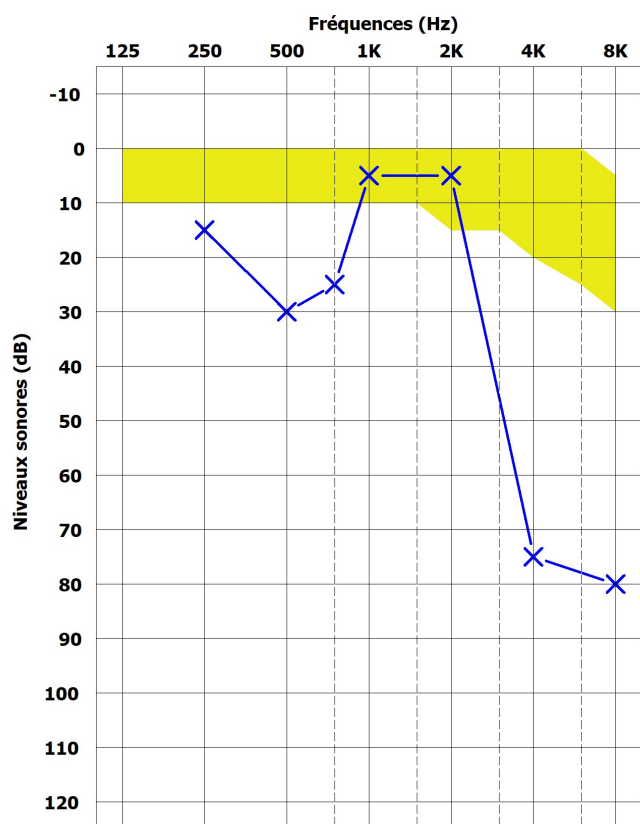

Oreille Gauche

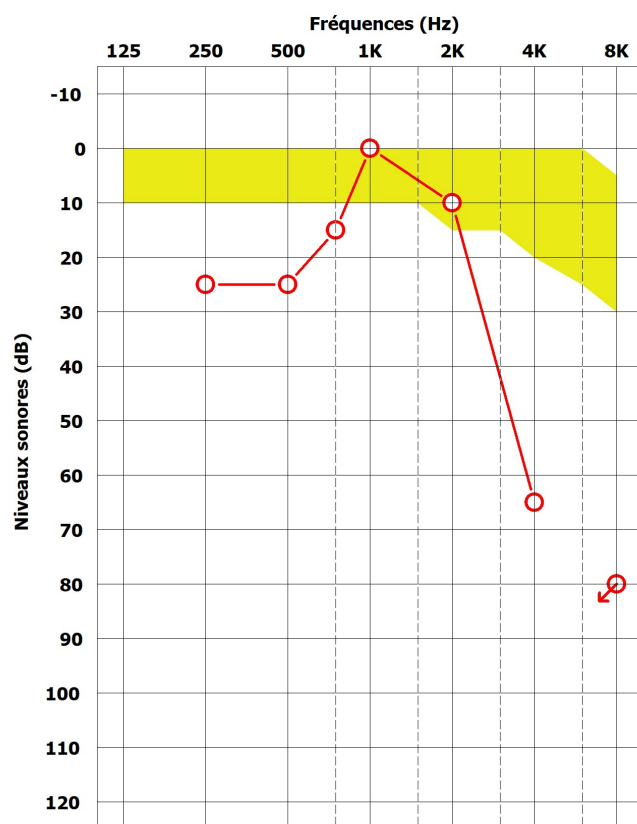

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	30	25	5		5		75		80
CA Droit		25	25	15	0		10		65		(80)

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes