

MEDVIE


Date du test: 07/08/2025 11:53:03

Durée: 4mn 42s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CONDE MOHAMED
Date de naissance	15/02/1995
Age	30
Société	CR18
ID	25080711482867286

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

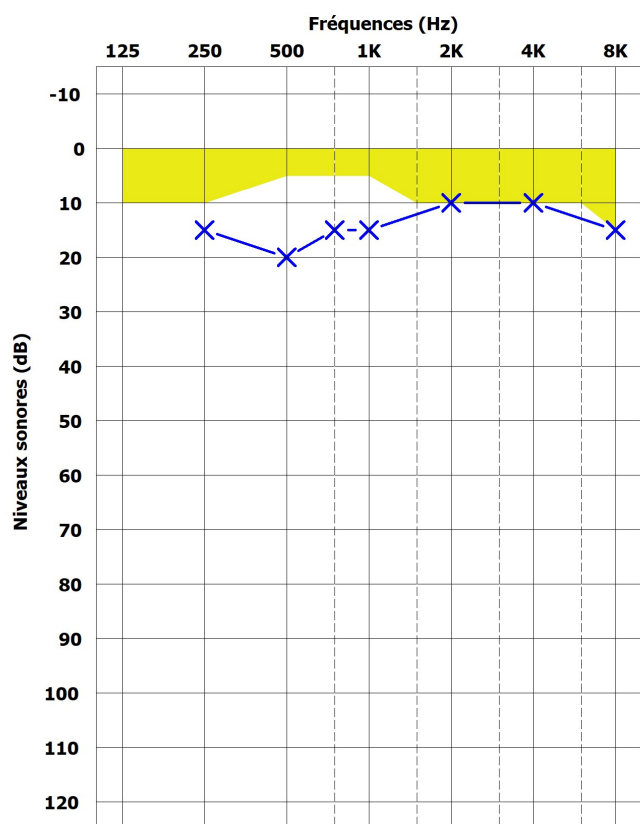

Oreille Gauche

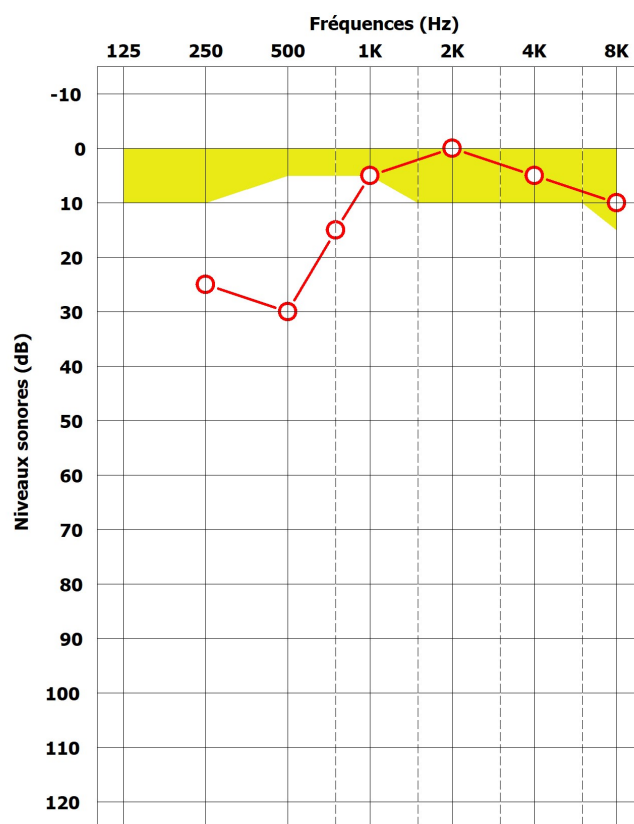

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	15	15		10		10		15
CA Droit		25	30	15	5		0		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes