

MEDVIE

Date du test: 05/08/2025 13:12:05
Durée: 5mn 23s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient

CAMARA ALY


Date de naissance: 01/01/1994
Age: 31
Société: CR18
ID: 25080513085590764

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

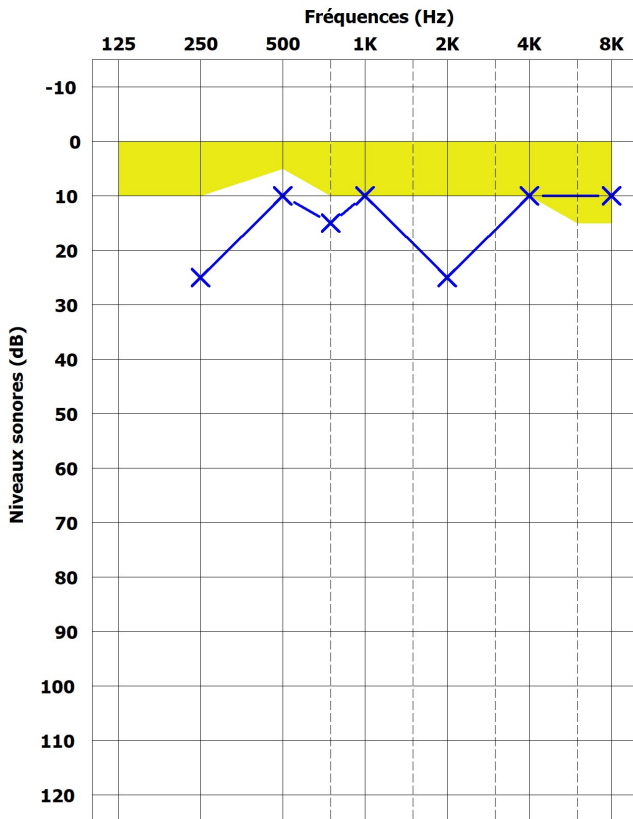

Oreille Gauche

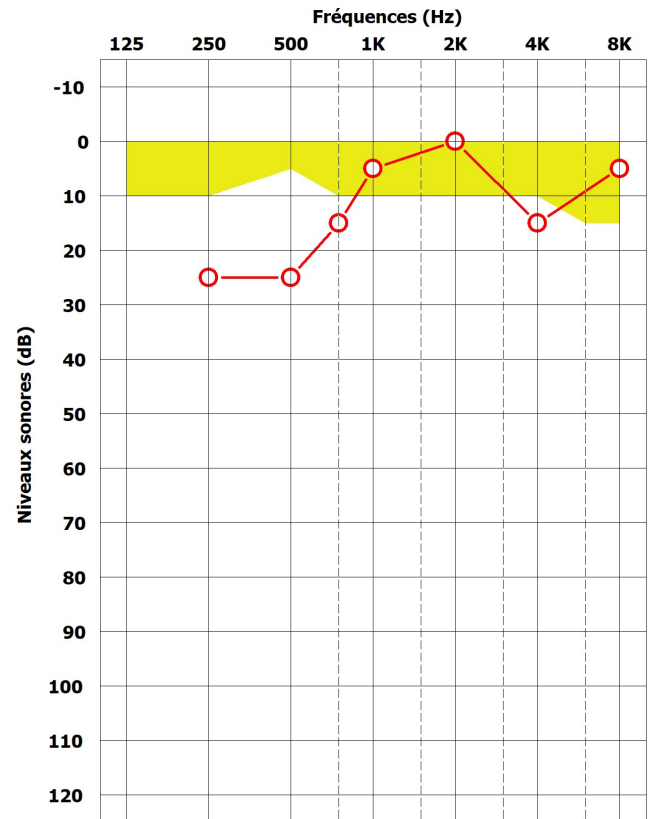

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	10	15	10		25		10		10
CA Droit		25	25	15	5		0		15		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes