

MEDVIE


Date du test: 01/05/2024 22:39:10

Durée: 8mn 11s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CHERIF MOHAMED	
Date de naissance	01/01/1981
Age	43
Société	CR18
ID	24050122380393666

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

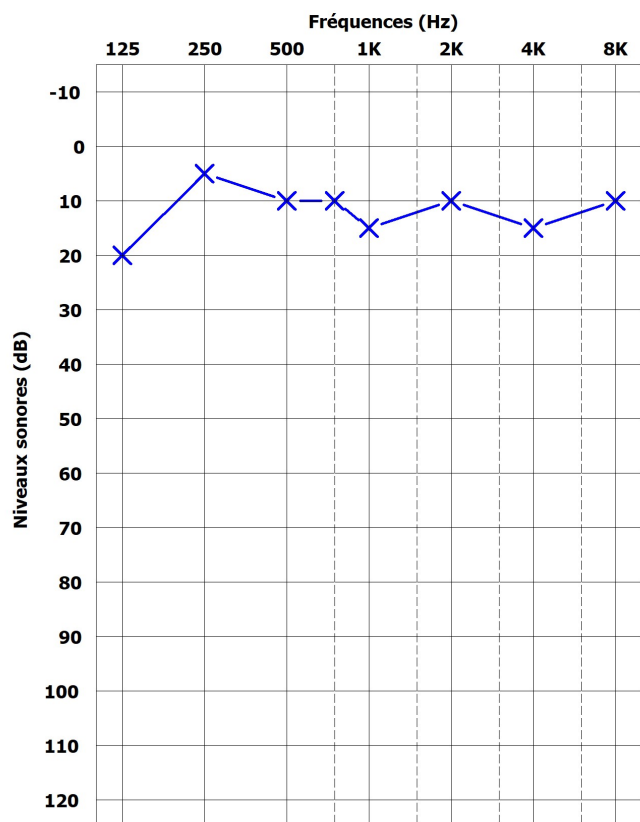

Oreille Gauche

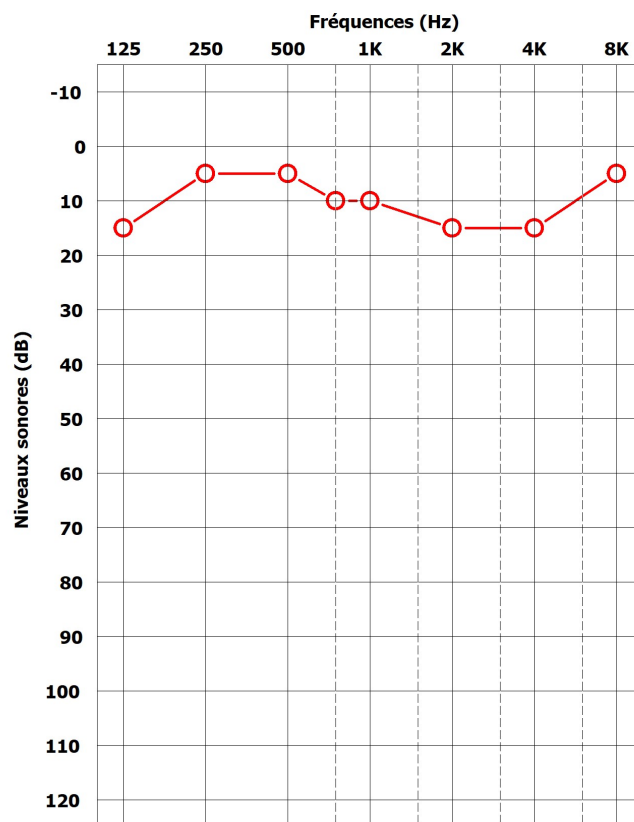

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	5	10	10	15		10		15		10
CA Droit	15	5	5	10	10		15		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes