

MEDVIE BEYLA


Date du test: 10/01/2025 16:20:34

Durée: 6mn 30s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   | KONATE LAYE |
|-------------------|-------------------|-------------|
| Date de naissance | 07/07/2000        |             |
| Age               | 24                |             |
| Société           | CR18              |             |
| ID                | 25011016174943221 |             |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

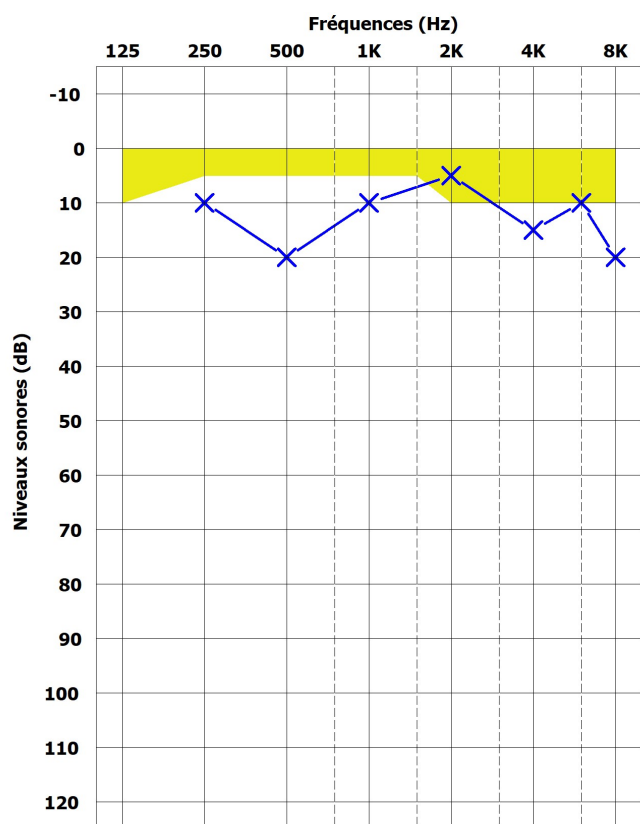

Oreille Gauche

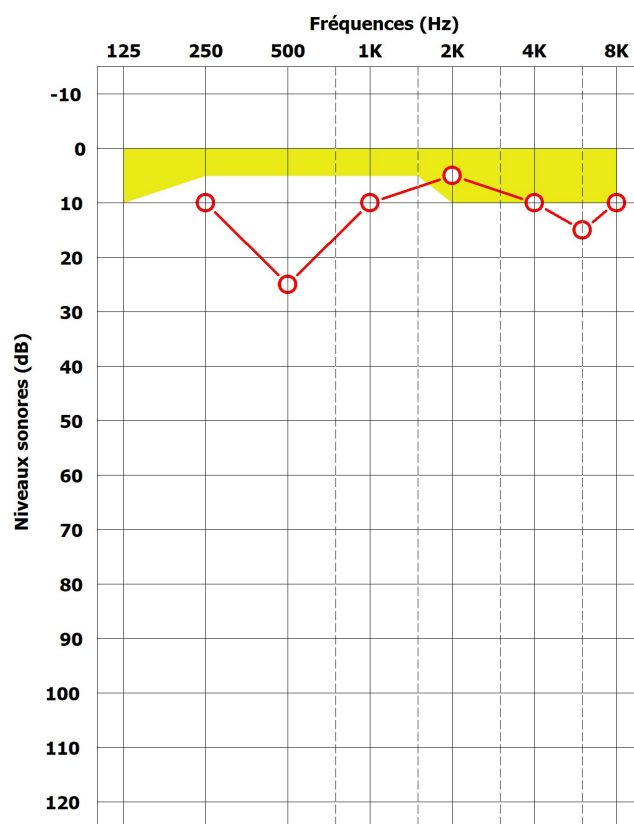

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 10  | 20  |     | 10 |     | 5  |    | 15 | 10 | 20 |
| CA Droit  |     | 10  | 25  |     | 10 |     | 5  |    | 10 | 15 | 10 |

| Calcul de perte |     | PAM     |
|-----------------|-----|---------|
| CA Gauche       | --- | 10,0 dB |
| CA Droit        | --- | 10,0 dB |

Notes