

MEDVIE

Date du test: 14/04/2025 13:08:50

Durée: 4mn 11s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

XIAO TAITUAN

Date de naissance

29/05/1971

Age

53

Société

CR18

ID

25041413070166575

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021

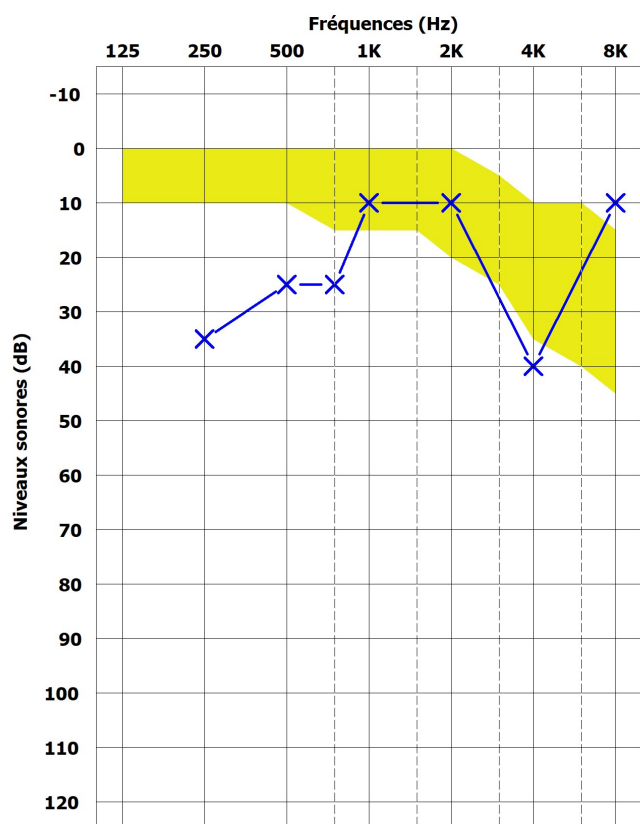

Oreille Gauche

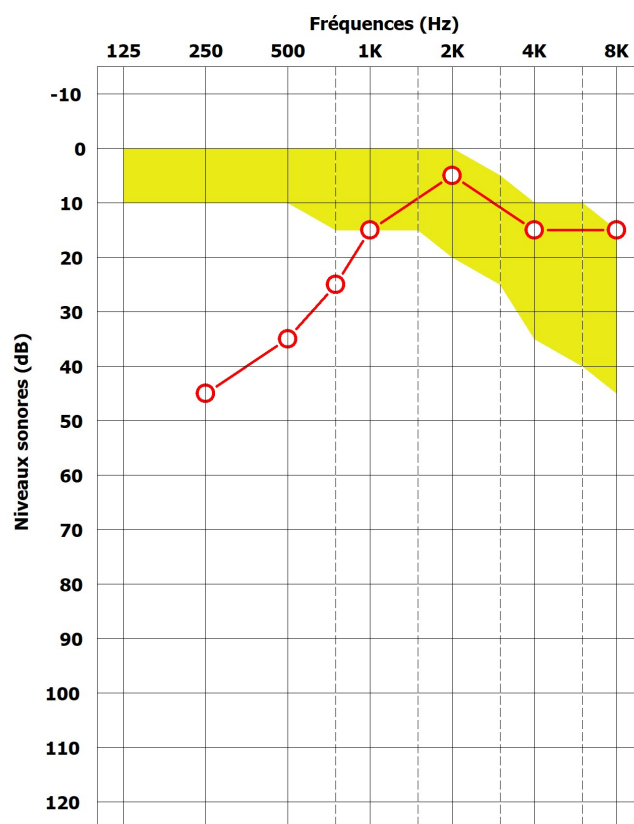

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	25	25	10		10		40		10
CA Droit		45	35	25	15		5		15		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes