


MEDVIE


Date du test: 20/08/2025 15:30:21
Durée: 4mn 23s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
MARA FACELY	
Date de naissance	01/01/1991
Age	34
Société	CR18
ID	25082015275625723

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

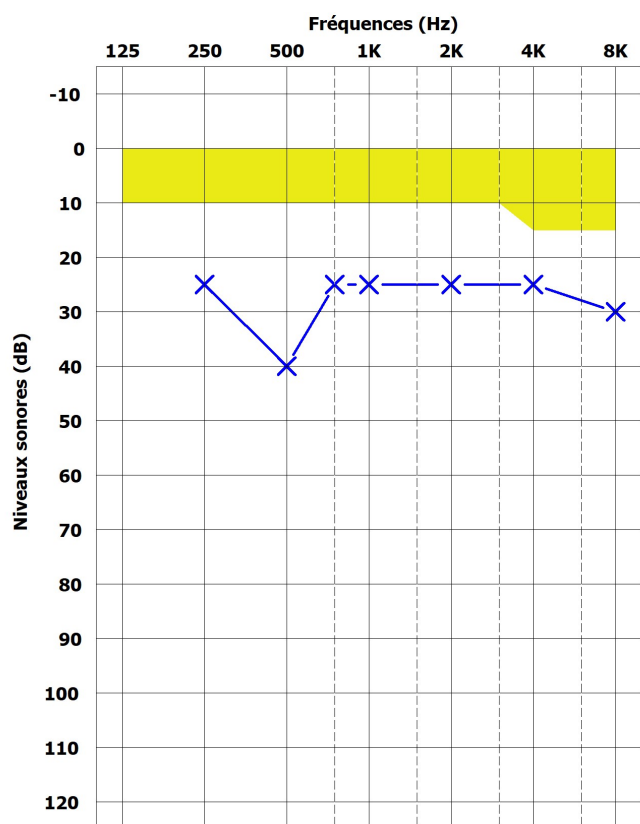

Oreille Gauche

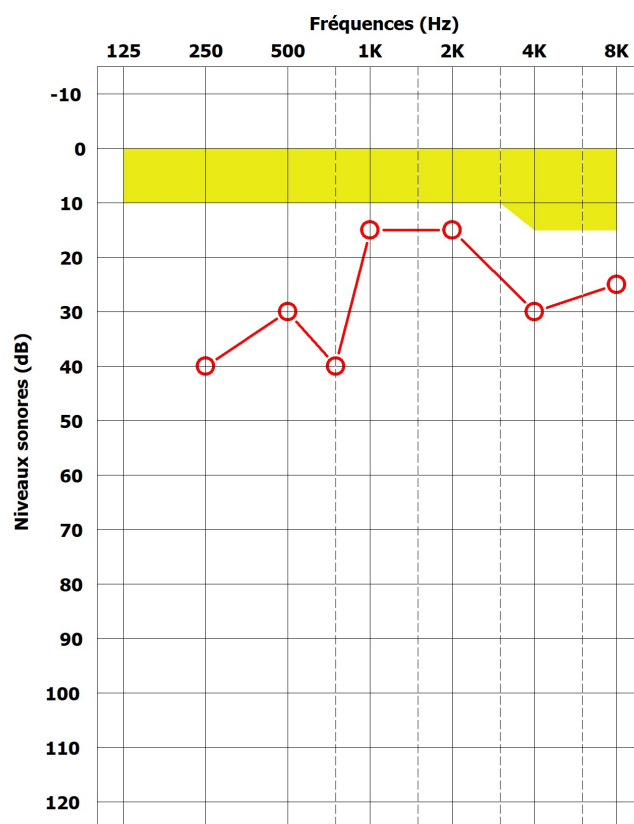

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	40	25	25		25		25		30
CA Droit		40	30	40	15		15		30		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes