


MEDVIE


Date du test: 15/05/2024 11:45:53
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient	
CHERIF MAMADY	
Date de naissance	01/01/1995
Age	29
Société	CR18
ID	24051511421555361

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

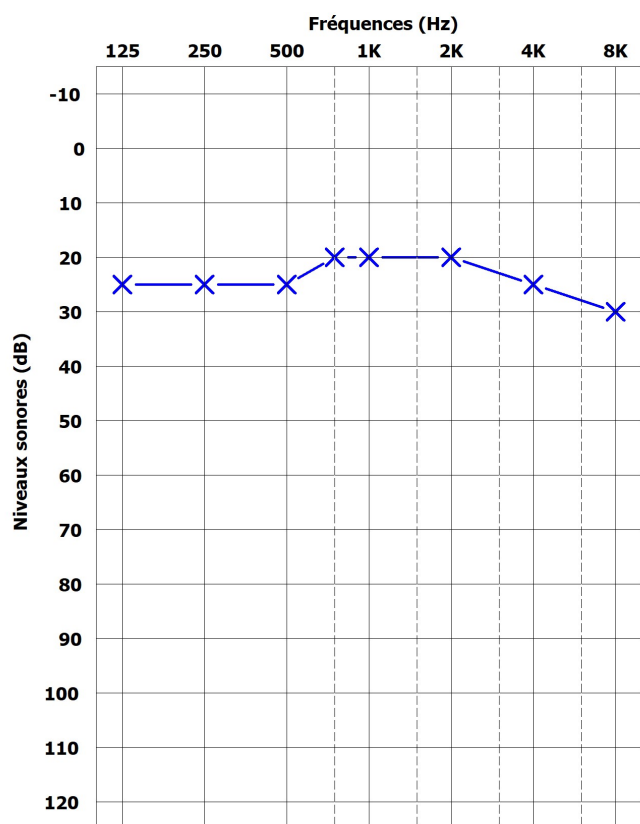

Oreille Gauche

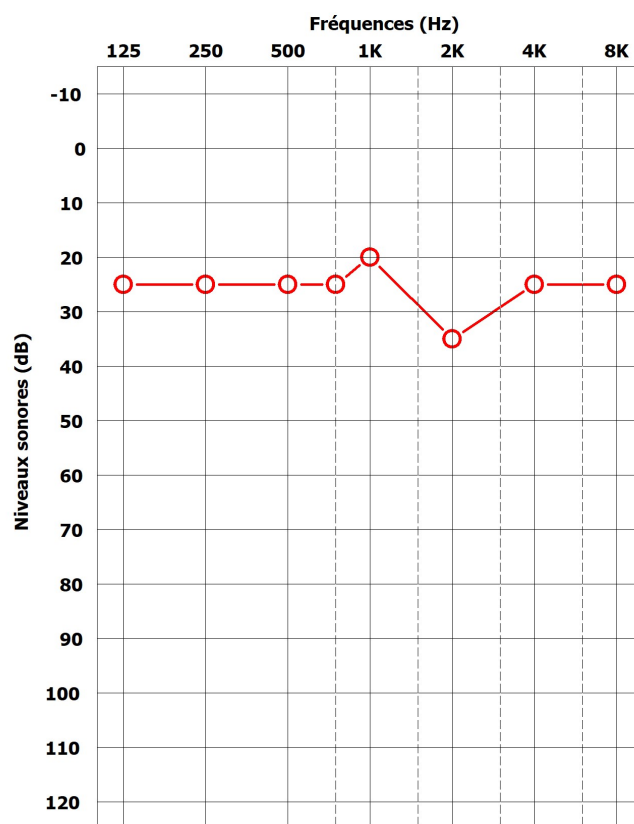

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	25	20	20		20		25		30
CA Droit	25	25	25	25	20		35		25		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes