

MEDVIE


Date du test: 11/07/2025 11:50:04

Durée: 4mn 46s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CHEN CHUANG
Date de naissance	12/08/1995
Age	29
Société	CR18
ID	25071111441102508

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

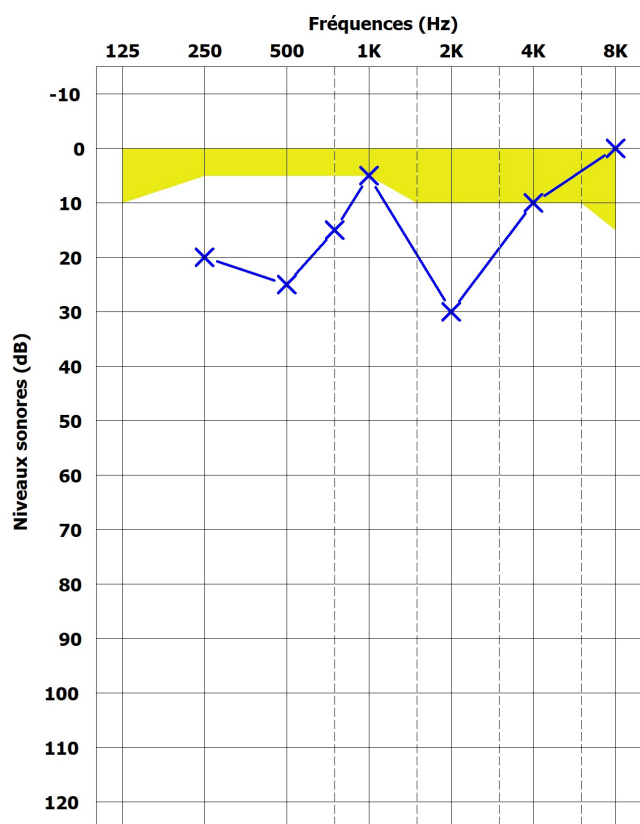

Oreille Gauche

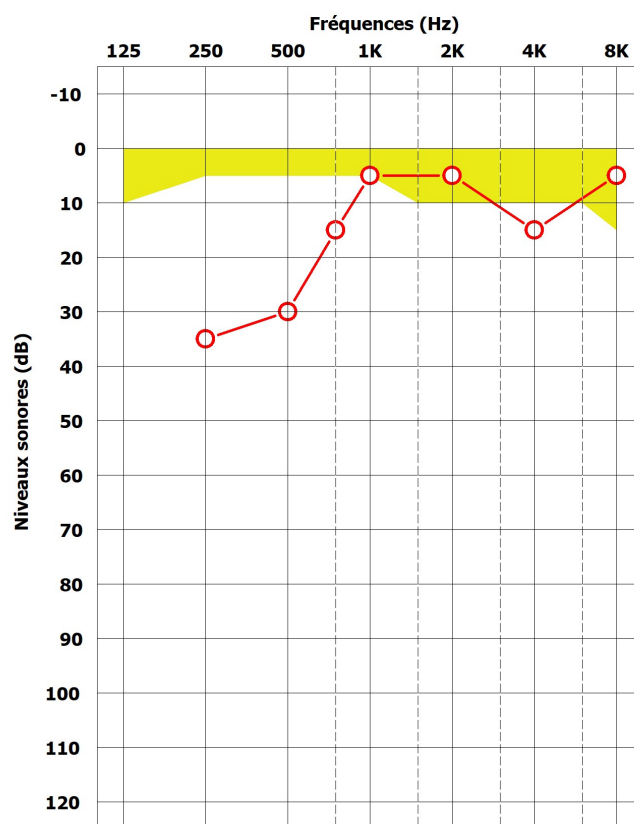

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	15	5		30		10		0
CA Droit		35	30	15	5		5		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes