


MEDVIE


Date du test: 09/08/2025 15:30:17  
Durée: 3mn 03s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   | CISSE DAOUDA |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Date de naissance | 01/01/1970        |              |
| Age               | 55                |              |
| Société           | CR18              |              |
| ID                | 25080914461341312 |              |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

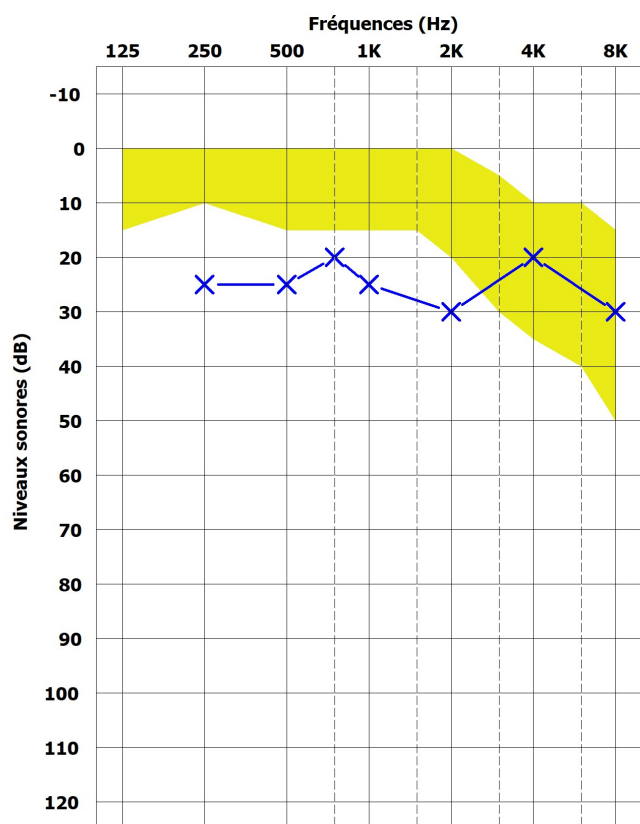

Oreille Gauche

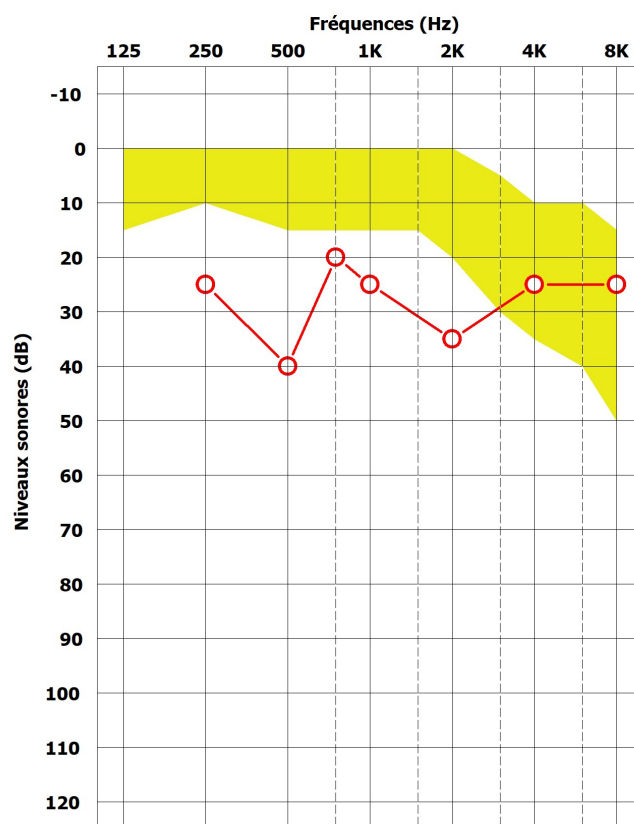

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 25  | 25  | 20  | 25 |     | 30 |    | 20 |    | 30 |
| CA Droit  |     | 25  | 40  | 20  | 25 |     | 35 |    | 25 |    | 25 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 25,0 dB | --- |
| CA Droit        | 31,3 dB | --- |

Notes