



| Données Patient   |                   | CAMARA Monamed<br>I amina |
|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Date de naissance | 24/11/2004        |                           |
| Age               | 19                |                           |
| Société           | cr18              |                           |
| ID                | 24022711292833831 |                           |

Date du test: 27/02/2024 11:31:27  
Durée: 4mn 28s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

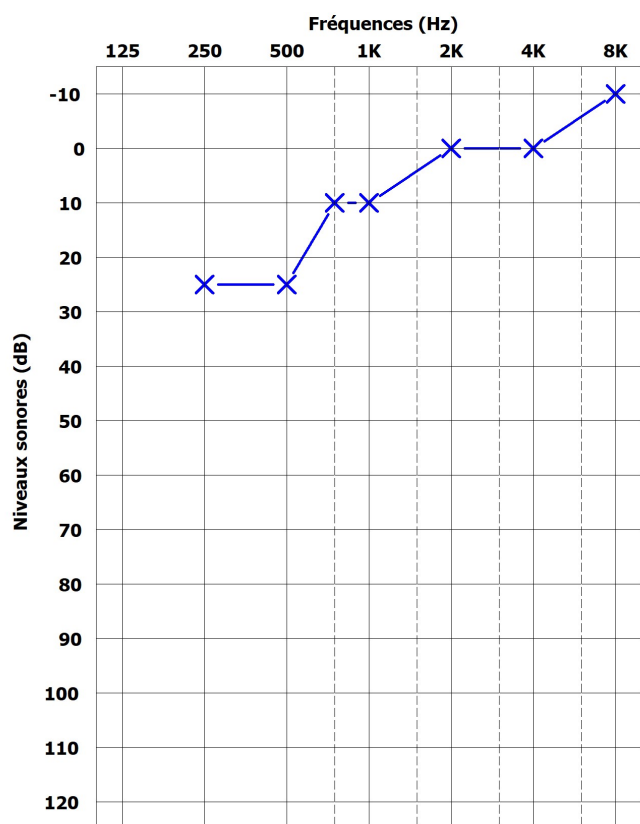

Oreille Gauche

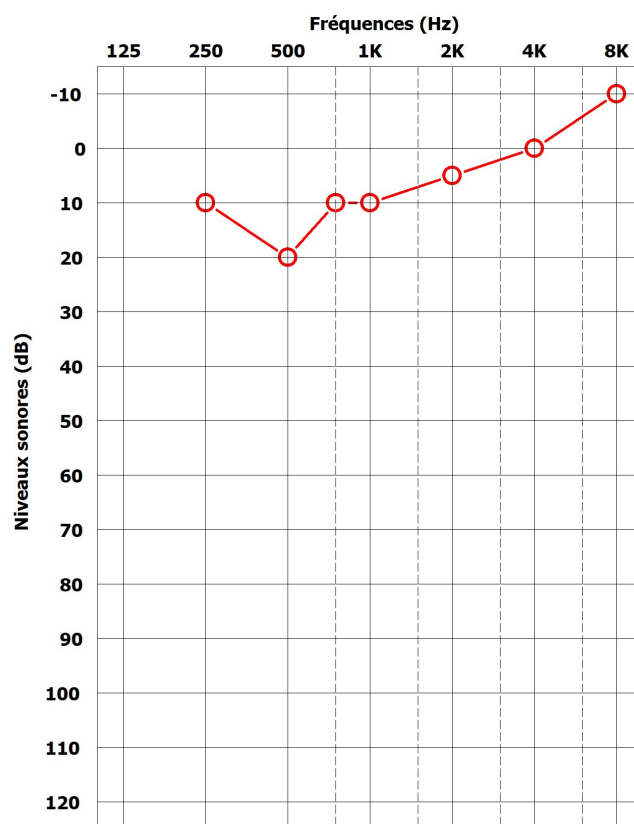

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|
| CA Gauche |     | 25  | 25  | 10  | 10 |     | 0  |    | 0  |    | -10 |
| CA Droit  |     | 10  | 20  | 10  | 10 |     | 5  |    | 0  |    | -10 |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 8,8 dB | --- |
| CA Droit        | 8,8 dB | --- |

Notes