


MEDVIE


Date du test: 17/05/2024 14:06:47
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		CISSE SIKA
Date de naissance	01/01/1999	
Age	25	
Société	CR18	
ID	24051714030827662	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

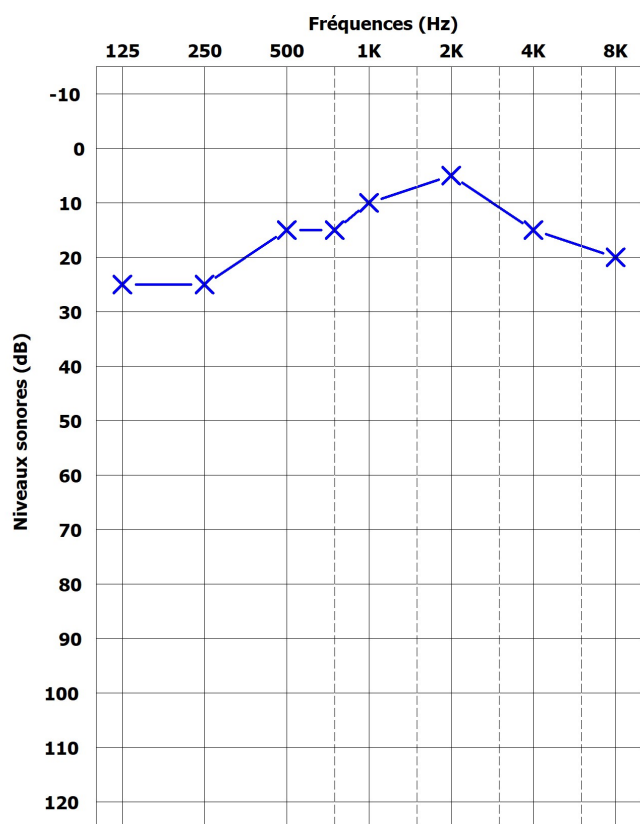

Oreille Gauche

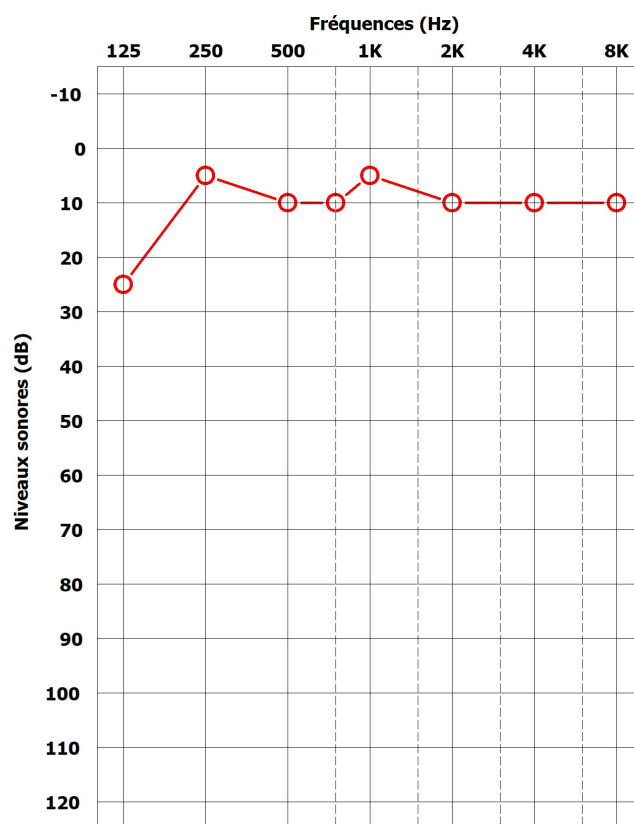

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	15	15	10		5		15		20
CA Droit	25	5	10	10	5		10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes