


MEDVIE


Date du test: 14/05/2024 14:13:13
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient	
SANGARE ANSOUMANE	
Date de naissance	01/01/2006
Age	18
Société	CR18
ID	24051414095736567

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

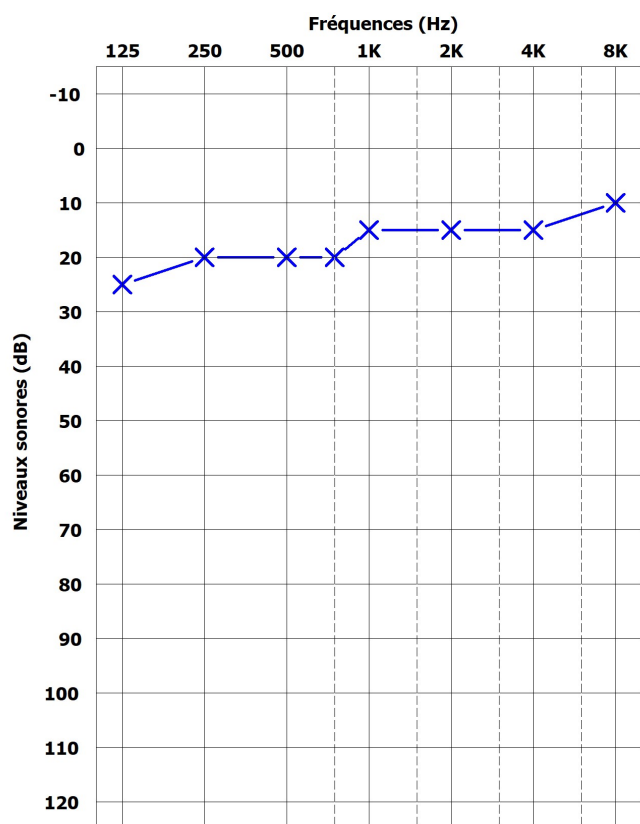

Oreille Gauche

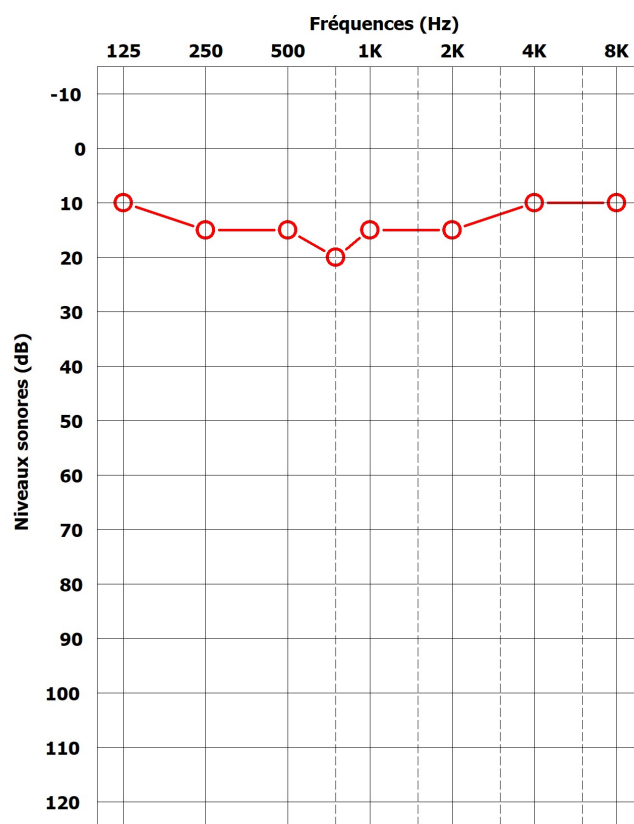

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	20	20	15		15		15		10
CA Droit	10	15	15	20	15		15		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes